NU SKIN.
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™

S3

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER

BENUTZERHANDBUCH

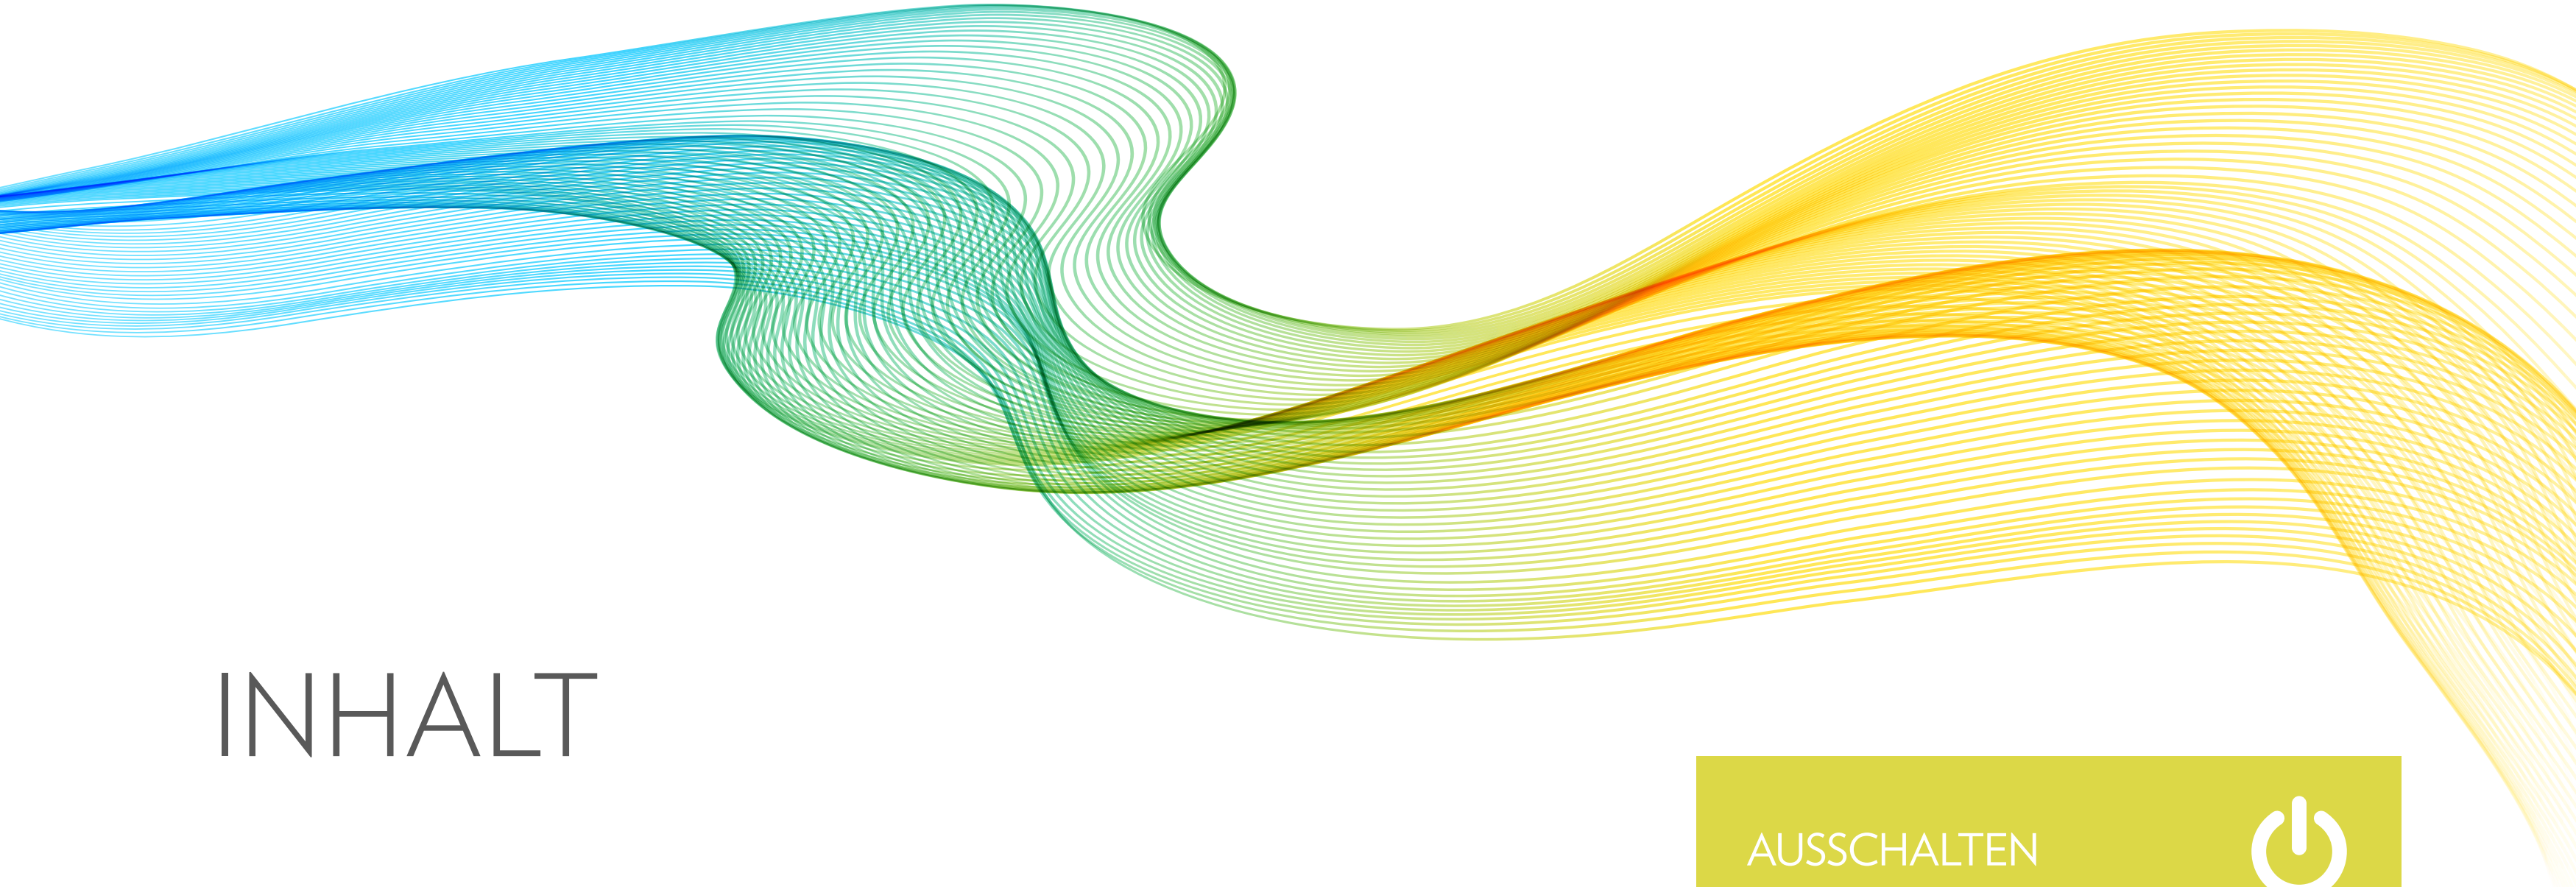

INHALT

AUF EINEN BLICK
SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE HINWEISE
DEN S3 VORBEREITEN
MIT DEM S3 SCANNEN
DEN S3 SYNCHRONISIEREN
AUSSCHALTEN
SUPPORT
TIPPS UND TRICKS
TECHNISCHE DATEN

AUF EINEN BLICK

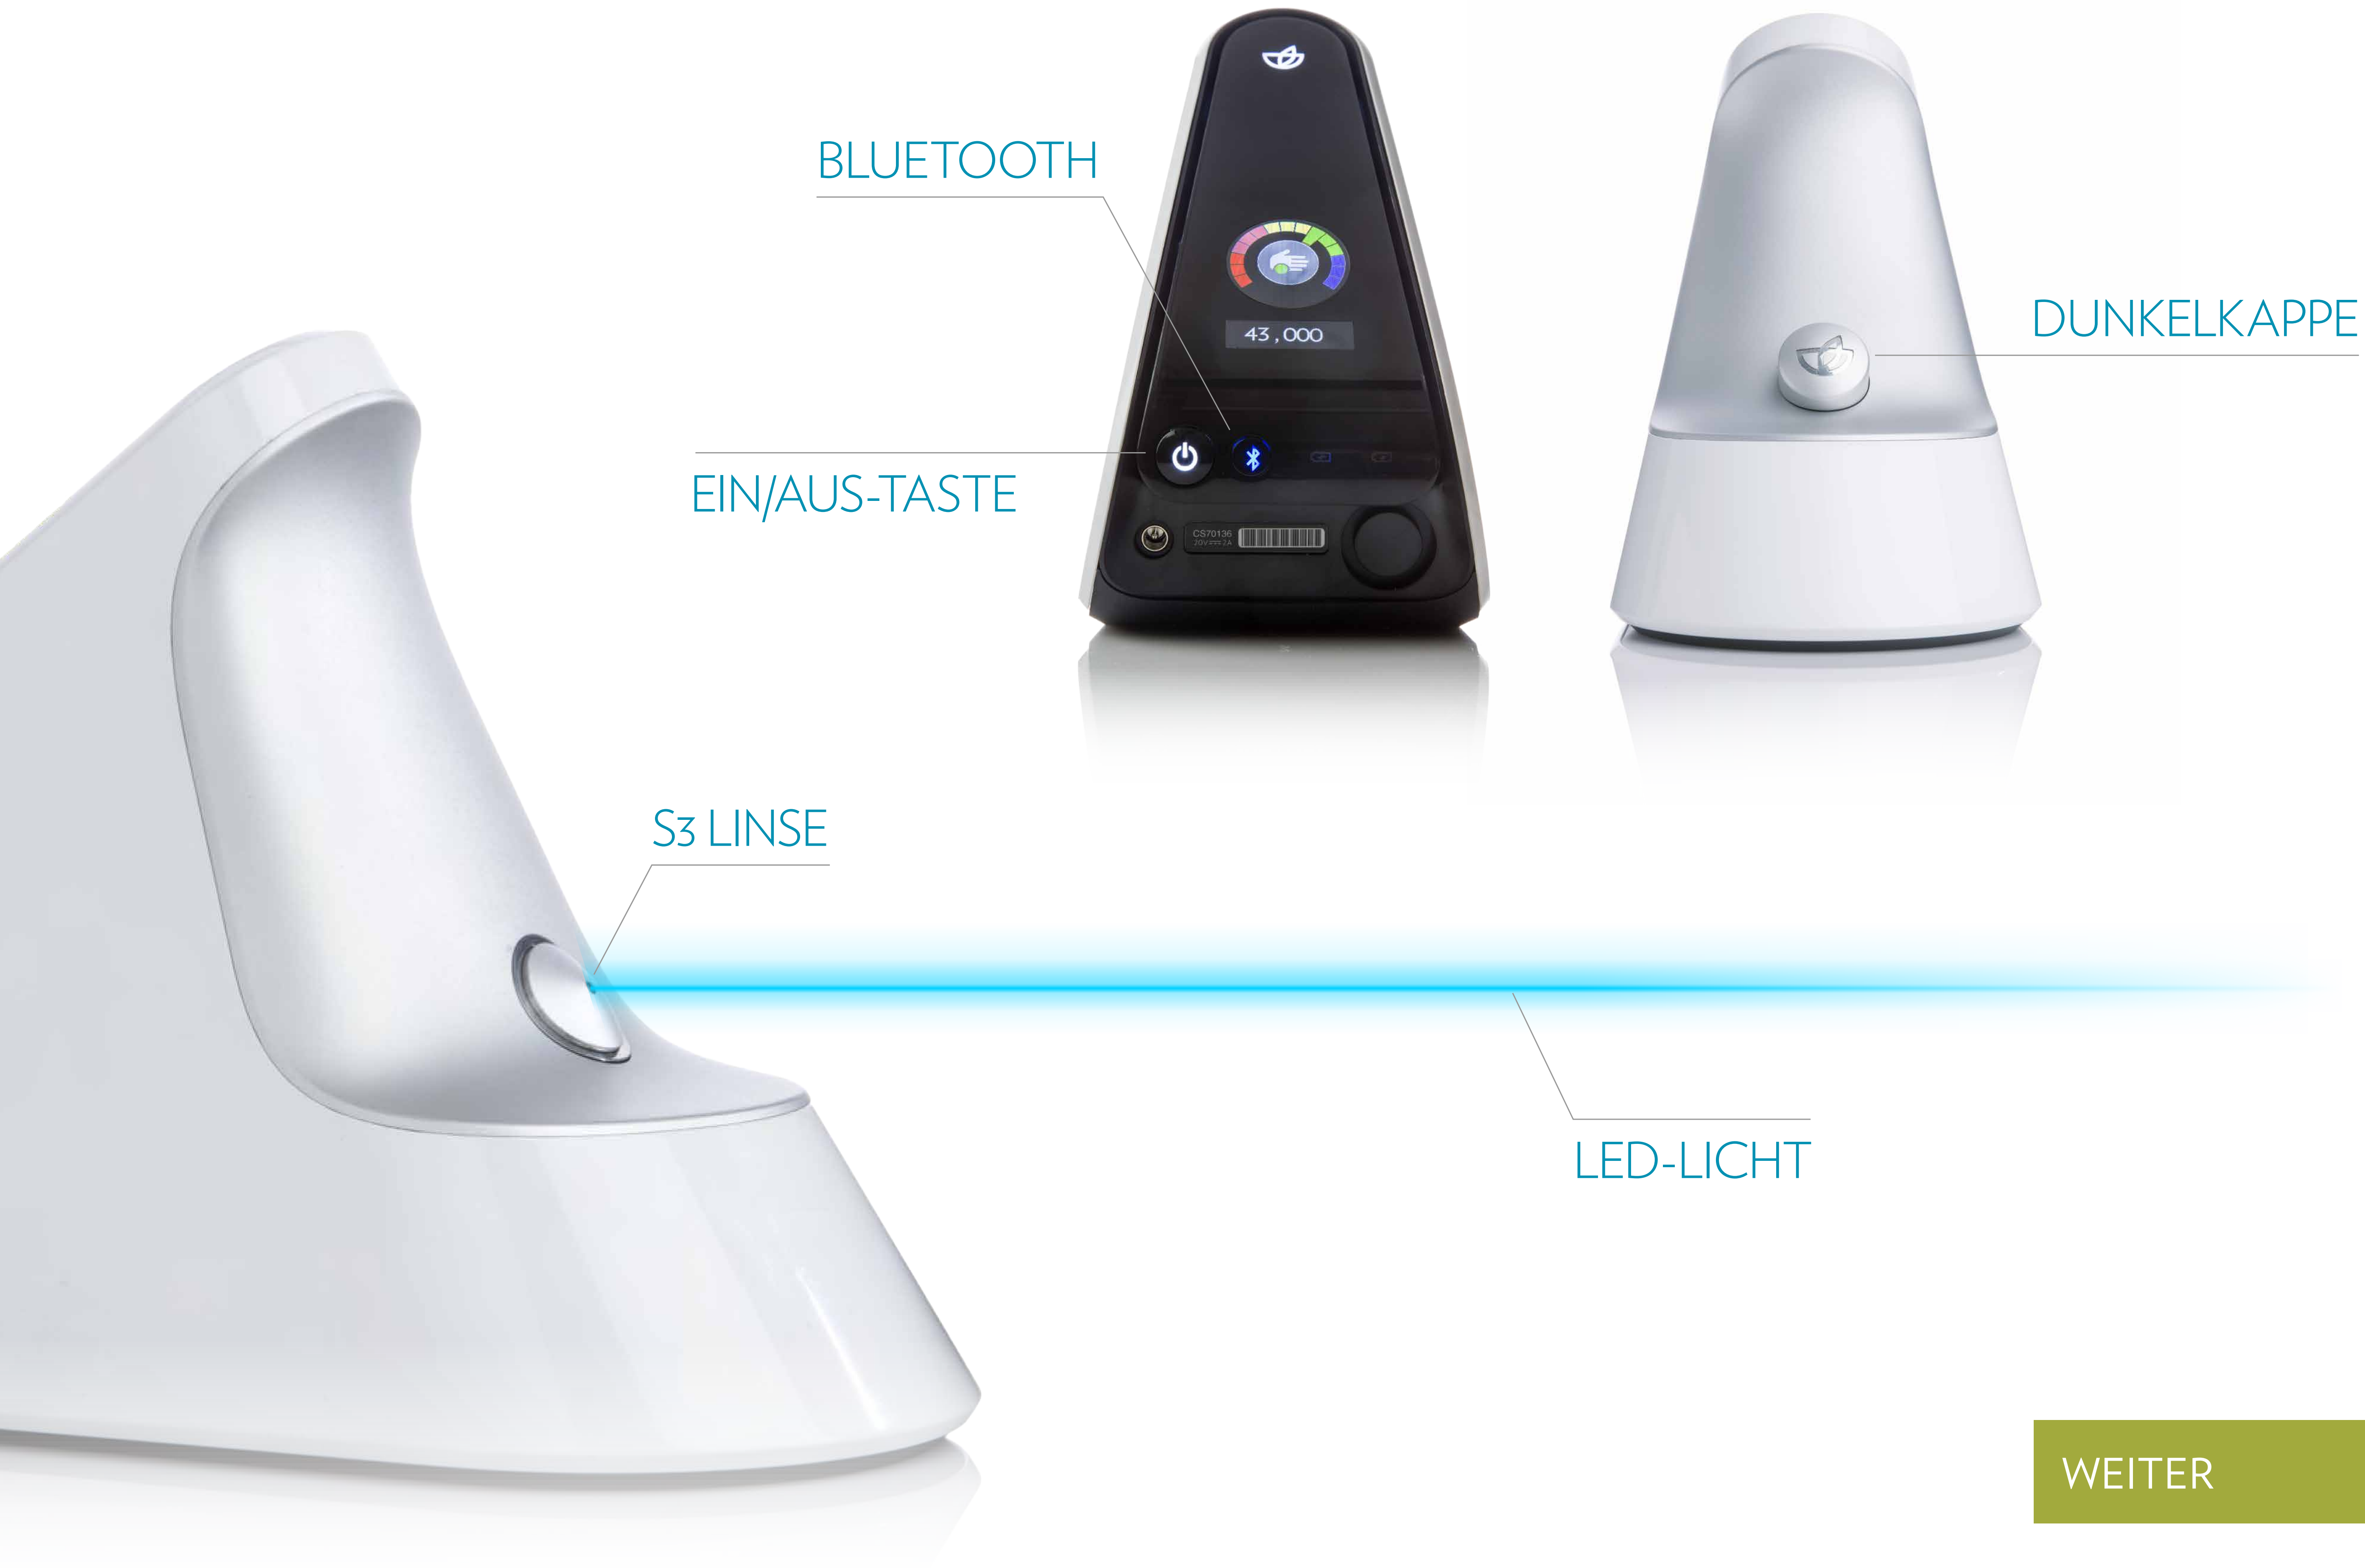
BLUETOOTH
EIN/AUS-TASTE
43,000
DUNKELKAPPE
S3 LINSE
LED-LICHT

WEITER >

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

Wichtiger Hinweis:
Wird das Gerät anders als nach diesen Sicherheitshinweisen verwendet, könnte dies zu einem Brand, einem Stromschlag oder anderen Verletzungen oder Schäden am S3, am iPad mini oder an anderem Eigentum führen. Lesen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme des S3 das gesamte Handbuch und alle Sicherheitshinweise durch, um den sicheren und korrekten Umgang mit dem Gerät zu gewährleisten.

UMGANG MIT DEM S3

Der Scanner ist ein hochempfindliches, wissenschaftliches Messgerät. Gehen Sie stets sorgsam damit um.

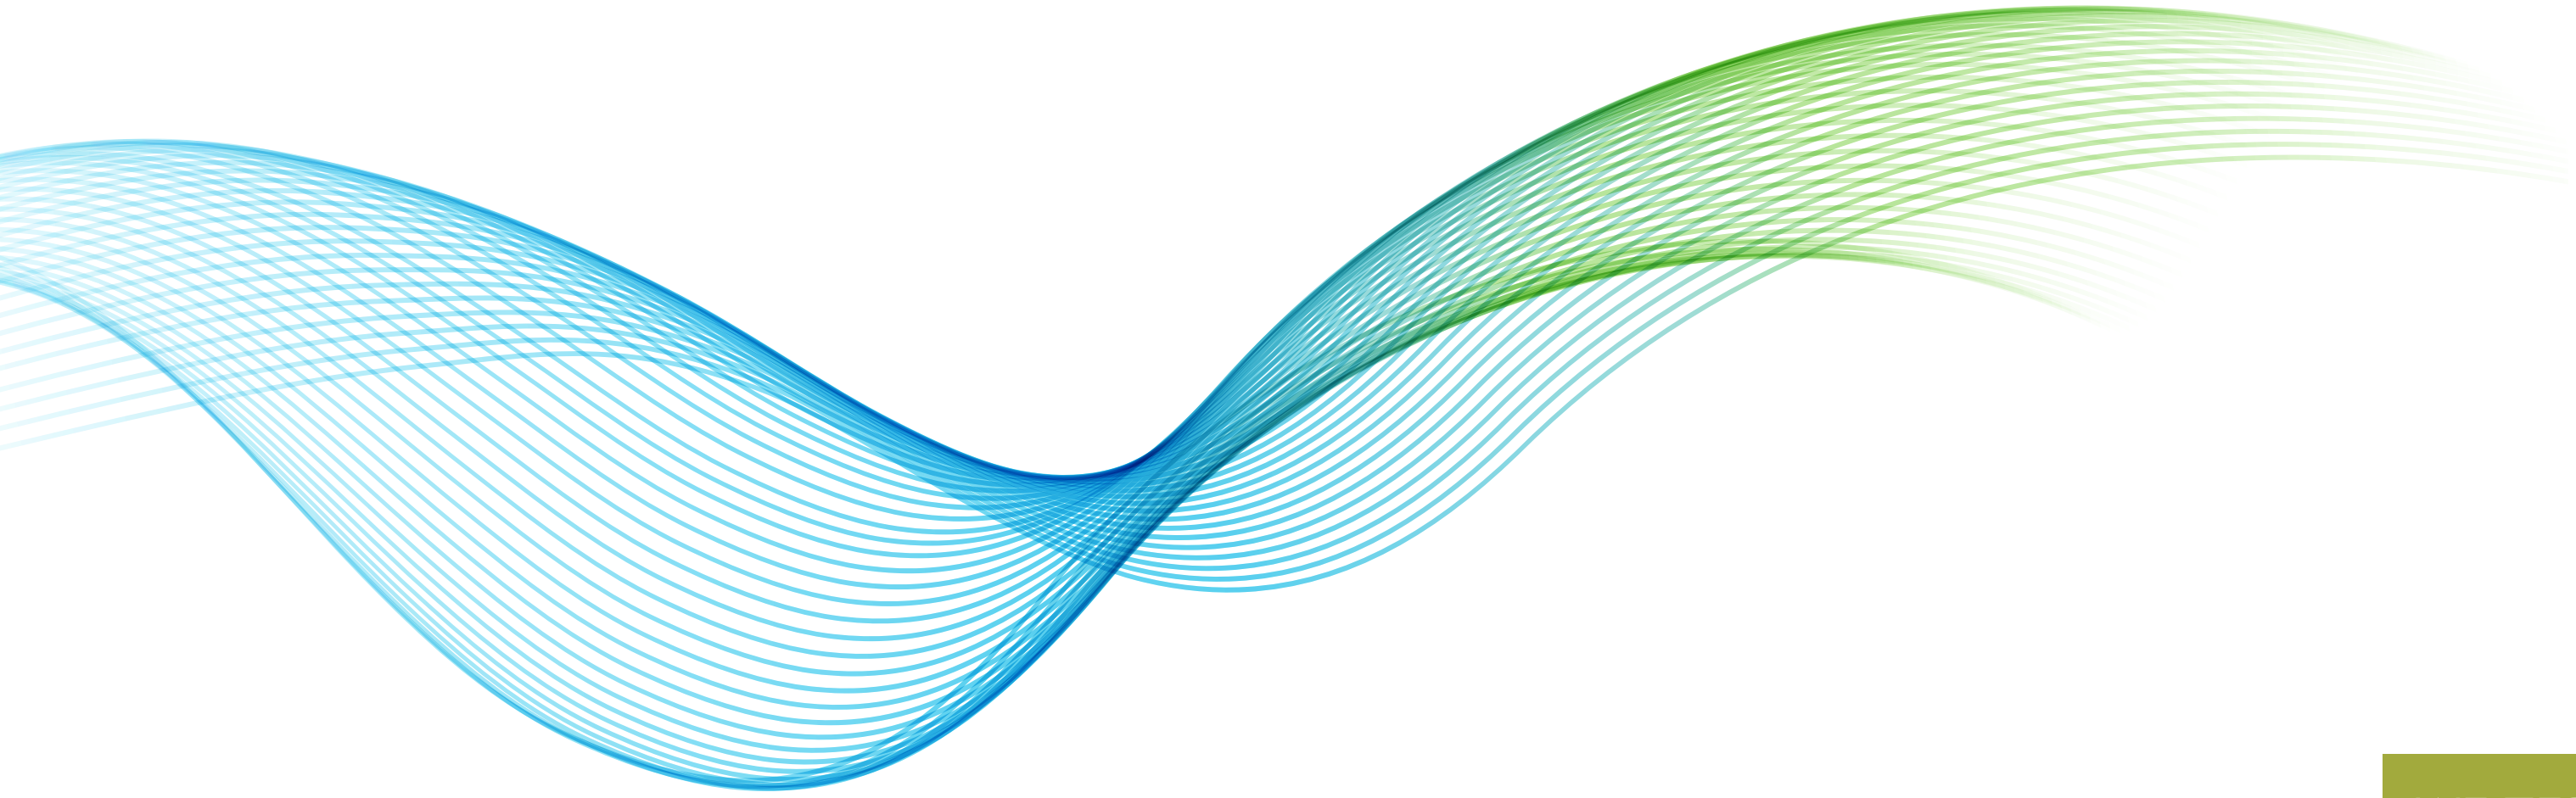

WEITER ›

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE

A. WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlages zu minimieren, setzen Sie den S3 weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Benutzen Sie den S3 nicht in der Nähe von Wasser, wie etwa in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Spüle, einer Waschmaschine, eines Swimmingpools oder anderer Behältnisse mit Flüssigkeit, und auch nicht in feuchten Kellerräumen. Sollte auf oder in der Nähe des S3 Flüssigkeit verschüttet werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Scanner-Support. Wenn der S3 nicht an einer Steckdose angeschlossen ist, jedoch im Akkubetrieb läuft, begeben Sie sich nicht in die Nähe des Gerätes, sondern wenden Sie sich an Ihren zuständigen Scanner-Support.

B. WARTUNG

Entfernen Sie nicht die Display-Abdeckung, das Gehäuse oder die Bodenplatte des S3. Versuchen Sie auch nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Die Demontage des Gerätes kann dessen Beschädigung oder eine Verletzung Ihrer Person zur Folge haben. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Die Wartung des S3 darf nur von qualifiziertem, technischem Pharmanex® Personal durchgeführt werden.

WEITER ›

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE

C. STROMKABEL UND NETZTEILE

Verwenden Sie für den S3 ausschließlich die mit dem Gerät mitgelieferten Stromkabel und Netzteile bzw. -stecker. Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel. Ein Schukostecker passt nur in eine für Schukostecker vorgesehene Steckdose. Verwenden Sie, falls benötigt, ausschließlich Verlängerungskabel mit Schukostecker.

D. KÜHLUNG

Der S3 sollte niemals in der Nähe eines Heizkörpers, Ofens oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden. Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit einer übermäßig warmen oder kalten Umgebung aus. Die optimale Temperatur zur Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 10 °C und 40 °C.

WEITER >

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

A. SCHUTZ DER AUGEN

Im Scanner werden LEDs (kurz für Light Emitting Diode; in Deutsch: Leuchtdioden) als Lichtquelle verwendet. Leuchtdioden werden in fast jedem Haushalt, bei Elektrogeräten und in herkömmlichen Taschenlampen genutzt. Obwohl sie allgemein nicht als schädlich für die Augen gelten, wird trotzdem dringend empfohlen, nicht aus kurzer Distanz oder längere Zeit in diese LED oder die von anderen hellen Lichtquellen zu blicken.

B. EMPFINDLICHE OPTISCHE KOMPONENTEN

Die optischen Komponenten des S3 können beschädigt werden, wenn diese sehr hellem Licht ausgesetzt werden. Scannen Sie keine glänzenden, spiegelnden oder metallischen Objekte, die das Licht in den S3 reflektieren. Scannen Sie keine extrem hellen Objekte. Richten Sie den S3 nicht auf helle Lampen oder in die Sonne. Decken Sie die Scanner-Linse mit der Dunkelkappe ab, wenn Sie das Gerät in einer sehr hellen Umgebung aufstellen und wenn es sich nicht in Gebrauch befindet. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zu Schäden an den empfindlichen optischen Komponenten im S3 führen.

WEITER >

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

C. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich wie von Pharmanex® vorgegeben zu verwenden und zu bedienen. Wird das Gerät anders als vorgeschrieben verwendet, können die Sicherheitseinrichtungen des Gerätes beeinträchtigt werden.

D. VERBUNDENES GERÄT

Der S3 wurde so konfiguriert, dass er ausschließlich mit dafür zugelassenen Geräten von Apple (aktuell das iPad mini) funktioniert. Wenn der S3 an unzulässige Geräte angeschlossen wird, können weder Synchronisationen noch Softwarefunktionen durchgeführt werden.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

WEITER >

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

WARTUNG

Die Wartung des S3 darf weder vom Benutzer noch ungenehmigt von Dritten durchgeführt werden. Der S3 darf nicht geöffnet oder auseinandergenommen werden. Sollte das Gehäuse des S3 beschädigt werden, versuchen Sie nicht, an die internen Komponenten oder elektrischen Schaltkreise zu gelangen. Dies könnte zum Kontakt mit der Elektronik führen und einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben. Um die Gefahr eines Stromschlages auszuschließen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung (falls zutreffend) und senden Sie den S3 zur Wartung an Pharmanex®.

HINWEIS:
Die Garantie für den S3 erlischt, wenn das Gehäuse in irgendeiner Weise manipuliert, ein Bestandteil des Gehäuses vorsätzlich entfernt oder nachweislich versucht wurde, das Gehäuse zu entfernen. In solchen Fällen erlischt nicht nur die Garantie, sondern der Scannerleasingnehmer haftet darüber hinaus in vollem Umfang für den Gerätepreis des S3.

WEITER >

UMGANG MIT DEM S3
ELEKTROGERÄT: WARNHINWEISE
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
WARTUNG

WARTUNG

Wann ist eine Wartung oder Reparatur notwendig?

Sollte einer der folgenden Zustände eintreten, ziehen Sie den Netzstecker des S3 (falls zutreffend) und rufen Sie den zuständigen Scanner-Support an:

- Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Es wurde Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet oder etwas ist auf oder in den Scanner gefallen.
- Das Gerät ist durch Regen, Spritz- oder Kondenswasser feucht oder nass geworden.
- Das Gerät funktioniert trotz Einhaltung der hier beschriebenen Bedienungsanweisungen nicht ordnungsgemäß.
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Das Gerät weist eine beträchtliche Leistungsminderung auf; es können z. B. keine einfachen Funktionen mehr ausgeführt werden.
- Die Scanner-App zum S3 fordert Sie dazu auf, sich an den technischen Support zu wenden.

WEITER >

- VERWENDUNGSZWECK
- KALIBRIERUNG
- BETRIEBSTEMPERATUR
- REISEN MIT DEM S3

VERWENDUNGSZWECK

Der Pharmanex® BioPhotonic Scanner (S3) ist ein Gerät zur Messung von Carotinoid-Mengen in der Haut. Es darf nicht zu medizinischen Zwecken verwendet werden. Es handelt sich weder um ein medizinisches Gerät noch um ein Instrument zur Erstellung von Diagnosen. Das Gerät kann daher in keiner Weise Erkrankungen vorbeugen oder diese diagnostizieren, behandeln, lindern oder heilen und hat keinen Einfluss auf die Struktur oder Funktion von Körperteilen.

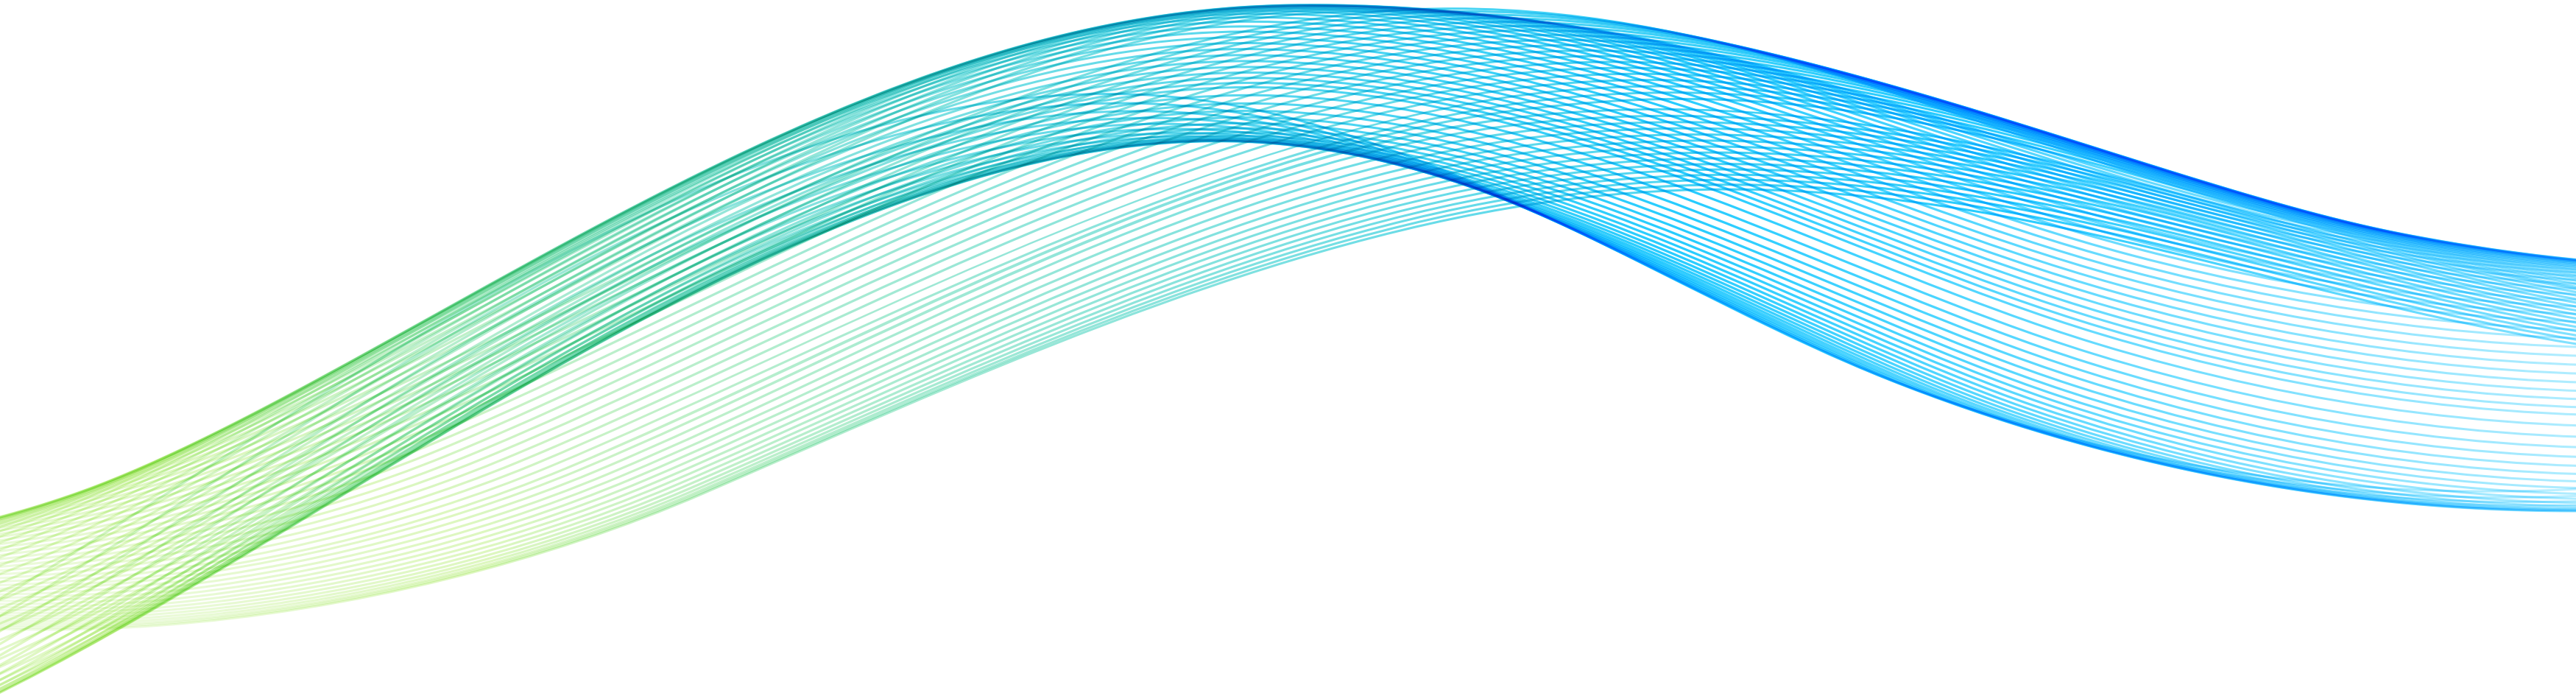

WEITER >

VERWENDUNGSZWECK
KALIBRIERUNG
BETRIEBSTEMPERATUR
REISEN MIT DEM S3

KALIBRIERUNG

Jedes wissenschaftliche Präzisionsgerät muss kalibriert werden. Die meisten werden täglich kalibriert, bei manchen erfolgt die Kalibrierung vor jeder einzelnen Messung. Beim ersten Gebrauch des S3 müssen ein Dunkelkappenscan mit der Abdeckkappe und ein Operator-Scan durchgeführt werden. Nach dieser ersten Kalibrierung muss alle 24 Stunden ein Dunkelkappenscan und alle 14 Tage ein Operator-Scan durchgeführt werden.

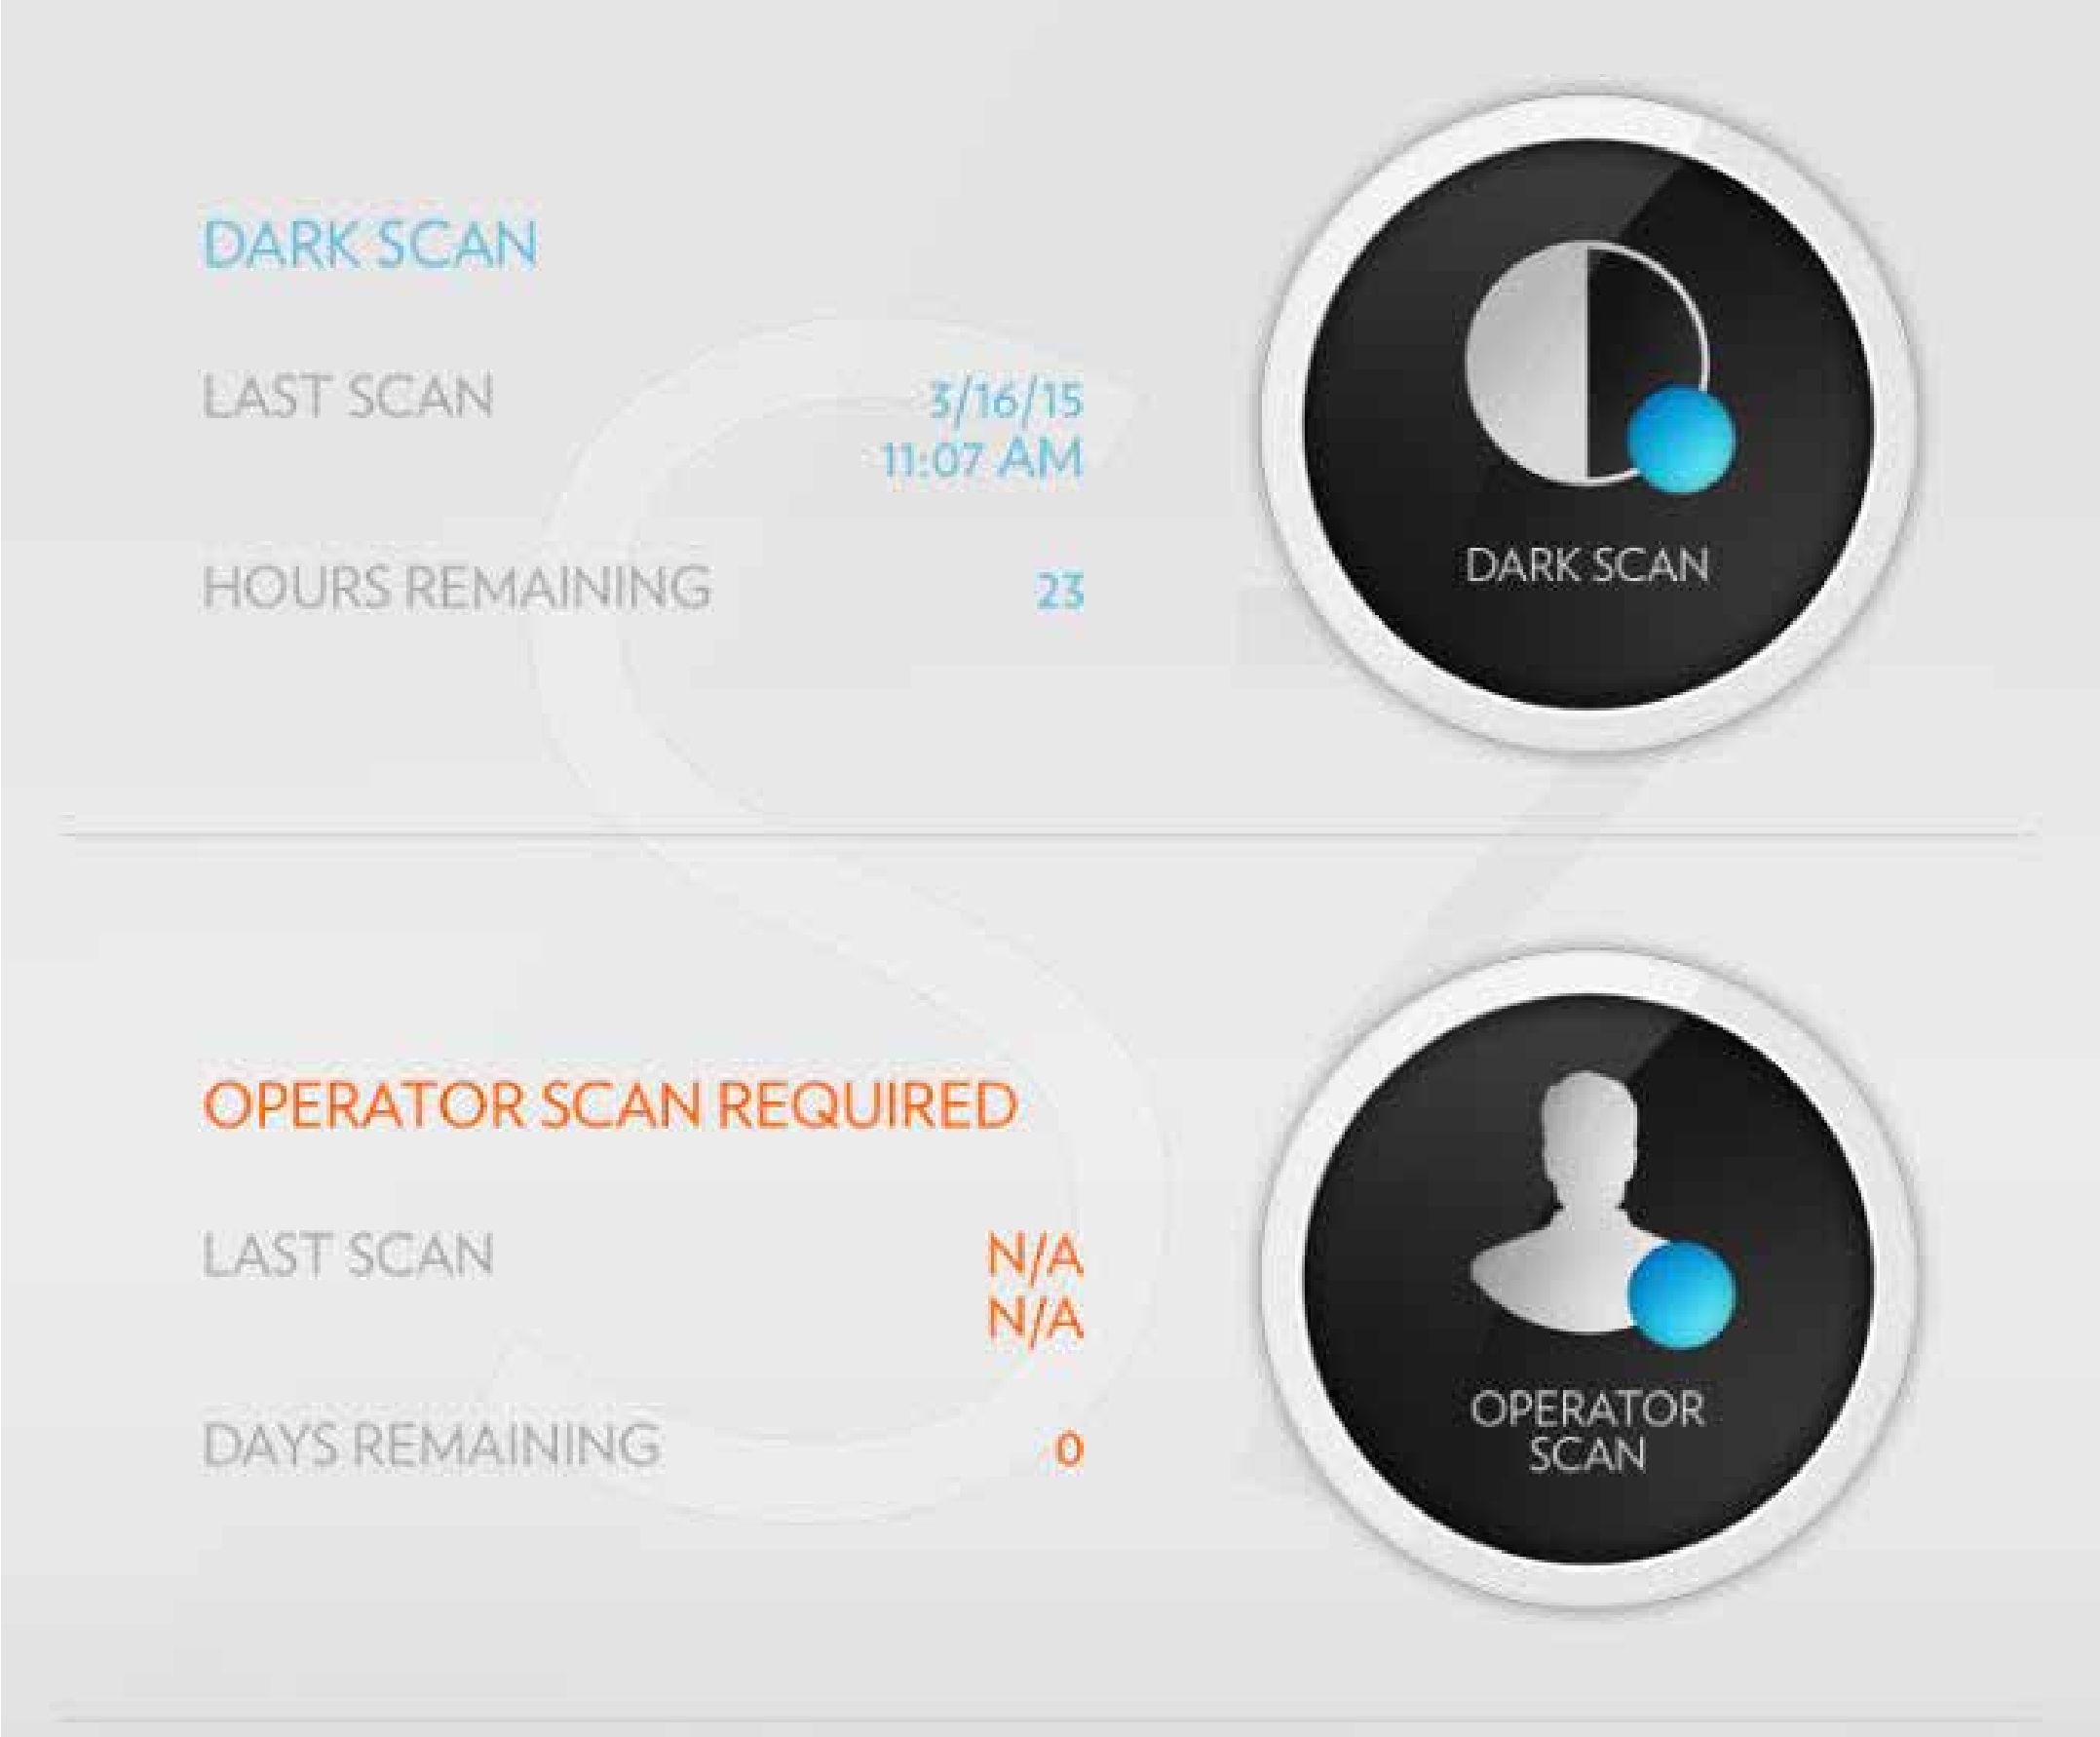

DARK SCAN

LAST SCAN 3/16/15 11:07 AM

HOURS REMAINING 23

OPERATOR SCAN REQUIRED

LAST SCAN N/A N/A

DAYS REMAINING 0

WEITER >

VERWENDUNGSZWECK
KALIBRIERUNG
BETRIEBSTEMPERATUR
REISEN MIT DEM S3

BETRIEBSTEMPERATUR

Die Umweltbedingungen, unter denen der S3 aufbewahrt und eingesetzt wird, können das Gerät beeinflussen. Der Scanner ist für eine Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C ausgelegt. **Die optimale Scantemperatur liegt bei 20 °C bis 25 °C.** Der S3 sollte nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 10 °C aufbewahrt oder transportiert werden. Wenn der S3 an einem heißen Tag oder in einer kalten Nacht im Auto gelassen wird, kann dies die Funktion des S3 beeinträchtigen oder zu Schäden am Gerät führen.

Wurde der Scanner bei Temperaturen aufbewahrt, die von den zuvor genannten Betriebstemperaturen abweichen (z. B. bei der Aufbewahrung in einem Auto über Nacht), benötigt dieser ausreichend Zeit, um sich an die Bedingungen der Betriebsumgebung anzupassen, bevor er aufgebaut und kalibriert werden kann. **Warten Sie ca. 30 Minuten, bevor Sie den S3 an die Stromversorgung anschließen oder versuchen, das Gerät zu kalibrieren, damit es sich an die Bedingungen der Scanumgebung anpassen kann.**

WEITER >

- VERWENDUNGSZWECK
- KALIBRIERUNG
- BETRIEBSTEMPERATUR
- REISEN MIT DEM S3

REISEN MIT DEM S3

Wenn Sie mit dem Scanner unterwegs sind, bewahren Sie ihn stets in der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Tragetasche auf. Beim Transport im Flugzeug sollte der S3 als Handgepäck mit an Bord genommen werden. So kann die Wahrscheinlichkeit von Erschütterungen und Stößen sowie extremen Temperaturen minimiert werden, die üblicherweise mit dem Ein- und Auschecken von Gepäck verbunden sind. Denken Sie daran, dass der S3 ein äußerst empfindliches, wissenschaftliches Gerät ist und deshalb immer dementsprechend behandelt werden sollte.

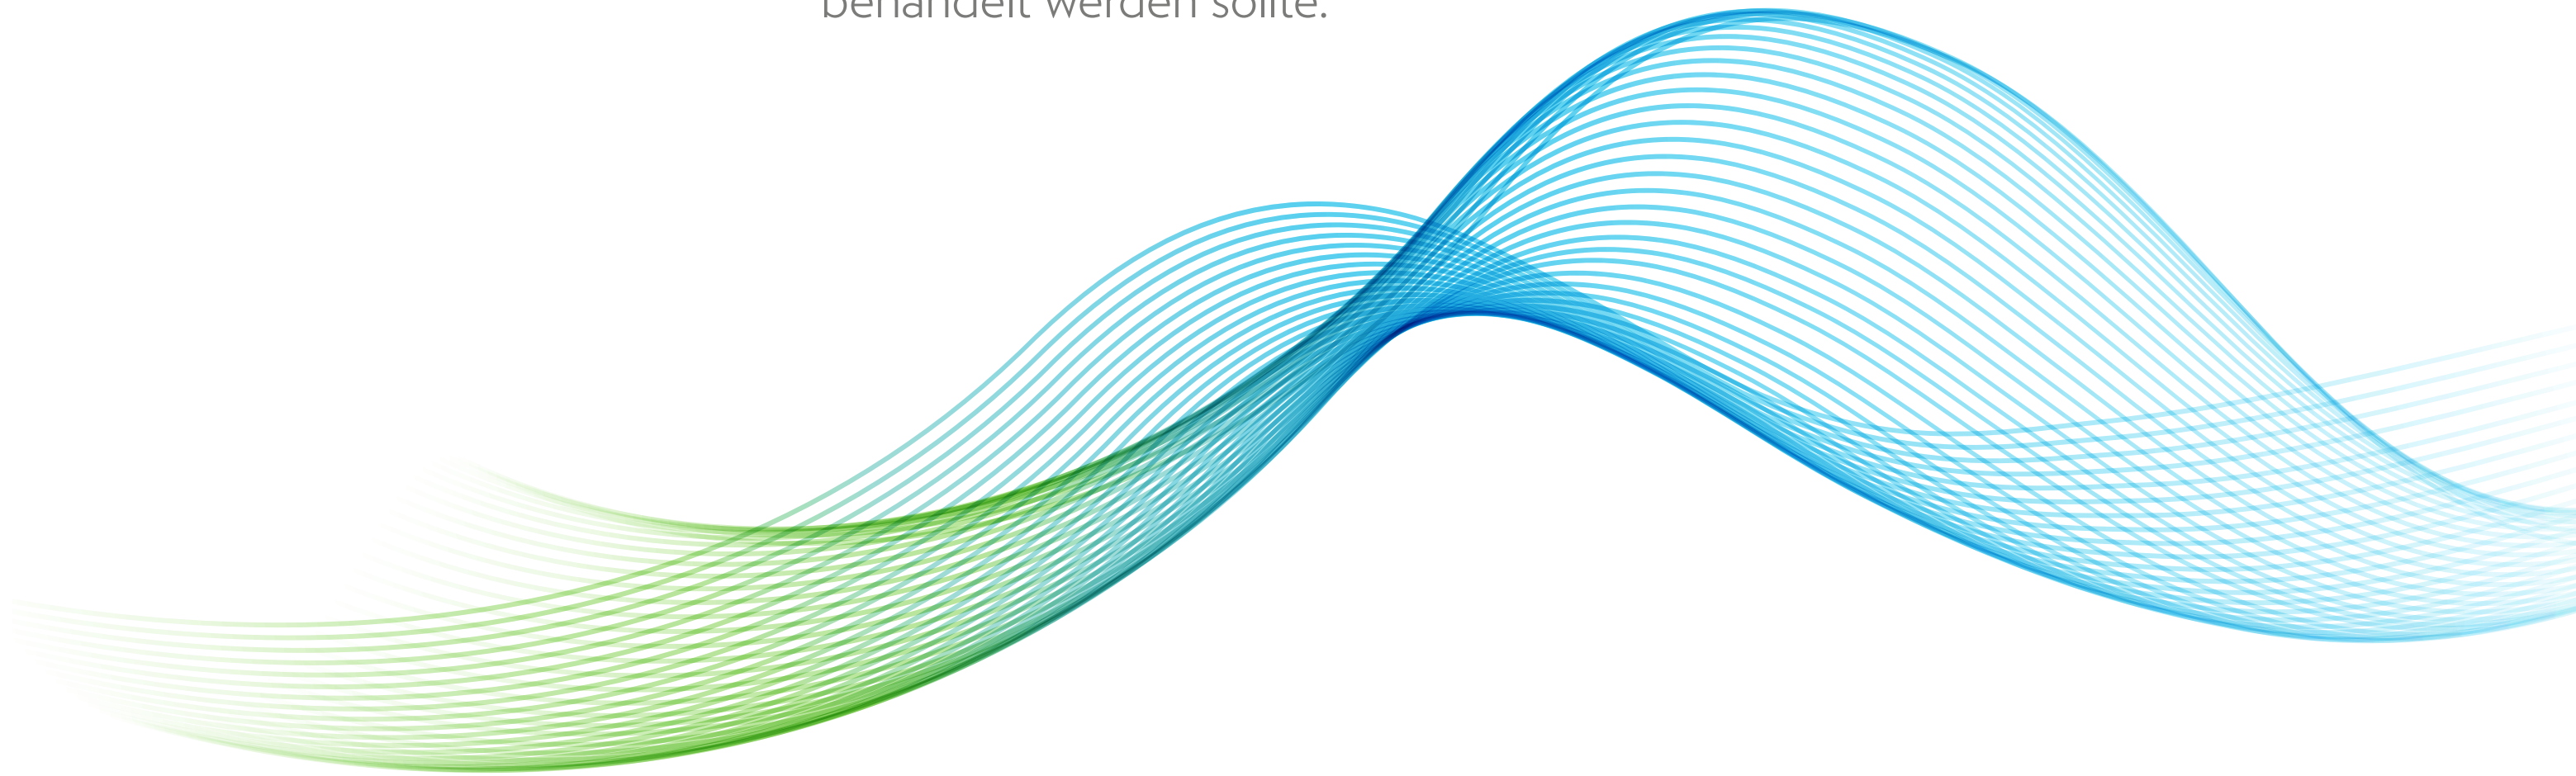

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN

Bitte überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob alle Komponenten enthalten sind.

- ✓ S3 Scanner

- ✓ Apple iPad mini* im Cover

- ✓ Netzteile, Kabel und Adapter

- ✓ Tragetasche für den S3 Scanner

- ✓ Dunkelscankappen für den S3 Scanner (insgesamt 2, eine auf dem Scanner und eine Ersatzkappe in der Tragetasche

*Für bestimmte Märkte gegebenenfalls nicht verfügbar

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DIE GERÄTE LADEN

Der Scanner und das iPad mini sollten mit den im Lieferumfang enthaltenen Netzteilen und Kabeln angeschlossen und mindestens 8 Stunden aufgeladen werden, bevor Sie sie zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

SO GEHT'S:

- Verbinden Sie ein Ende des S3 Stromkabels mit dem dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Scanners und das andere Ende mit einer (geerdeten) Steckdose.

  Die Ladekontroll-LED auf der Rückseite des S3 Scanners leuchtet grün auf, sobald der S3 aufgeladen wird.

- Verbinden Sie das USB-Kabel des iPad mini mit dem USB-Netzteil.
- Verbinden Sie ein Ende des iPad mini-Stromkabels unten mit dem iPad mini und das andere Ende mit einer Steckdose.

Sind sowohl der S3 als auch das iPad mini aufgeladen, können beide Geräte von der Stromversorgung getrennt werden.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN

GERÄTE LADEN

IPAD MINI AKTIVIEREN

IPAD VERBINDEN

S3 APP INSTALLIEREN

ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DAS IPAD MINI AKTIVIEREN

Drücken Sie die Standbytaste oben rechts am Gerät. Schieben Sie den Balken zum Entsperren auf dem Bildschirm nach rechts, um zum Home-Bildschirm zu gelangen.

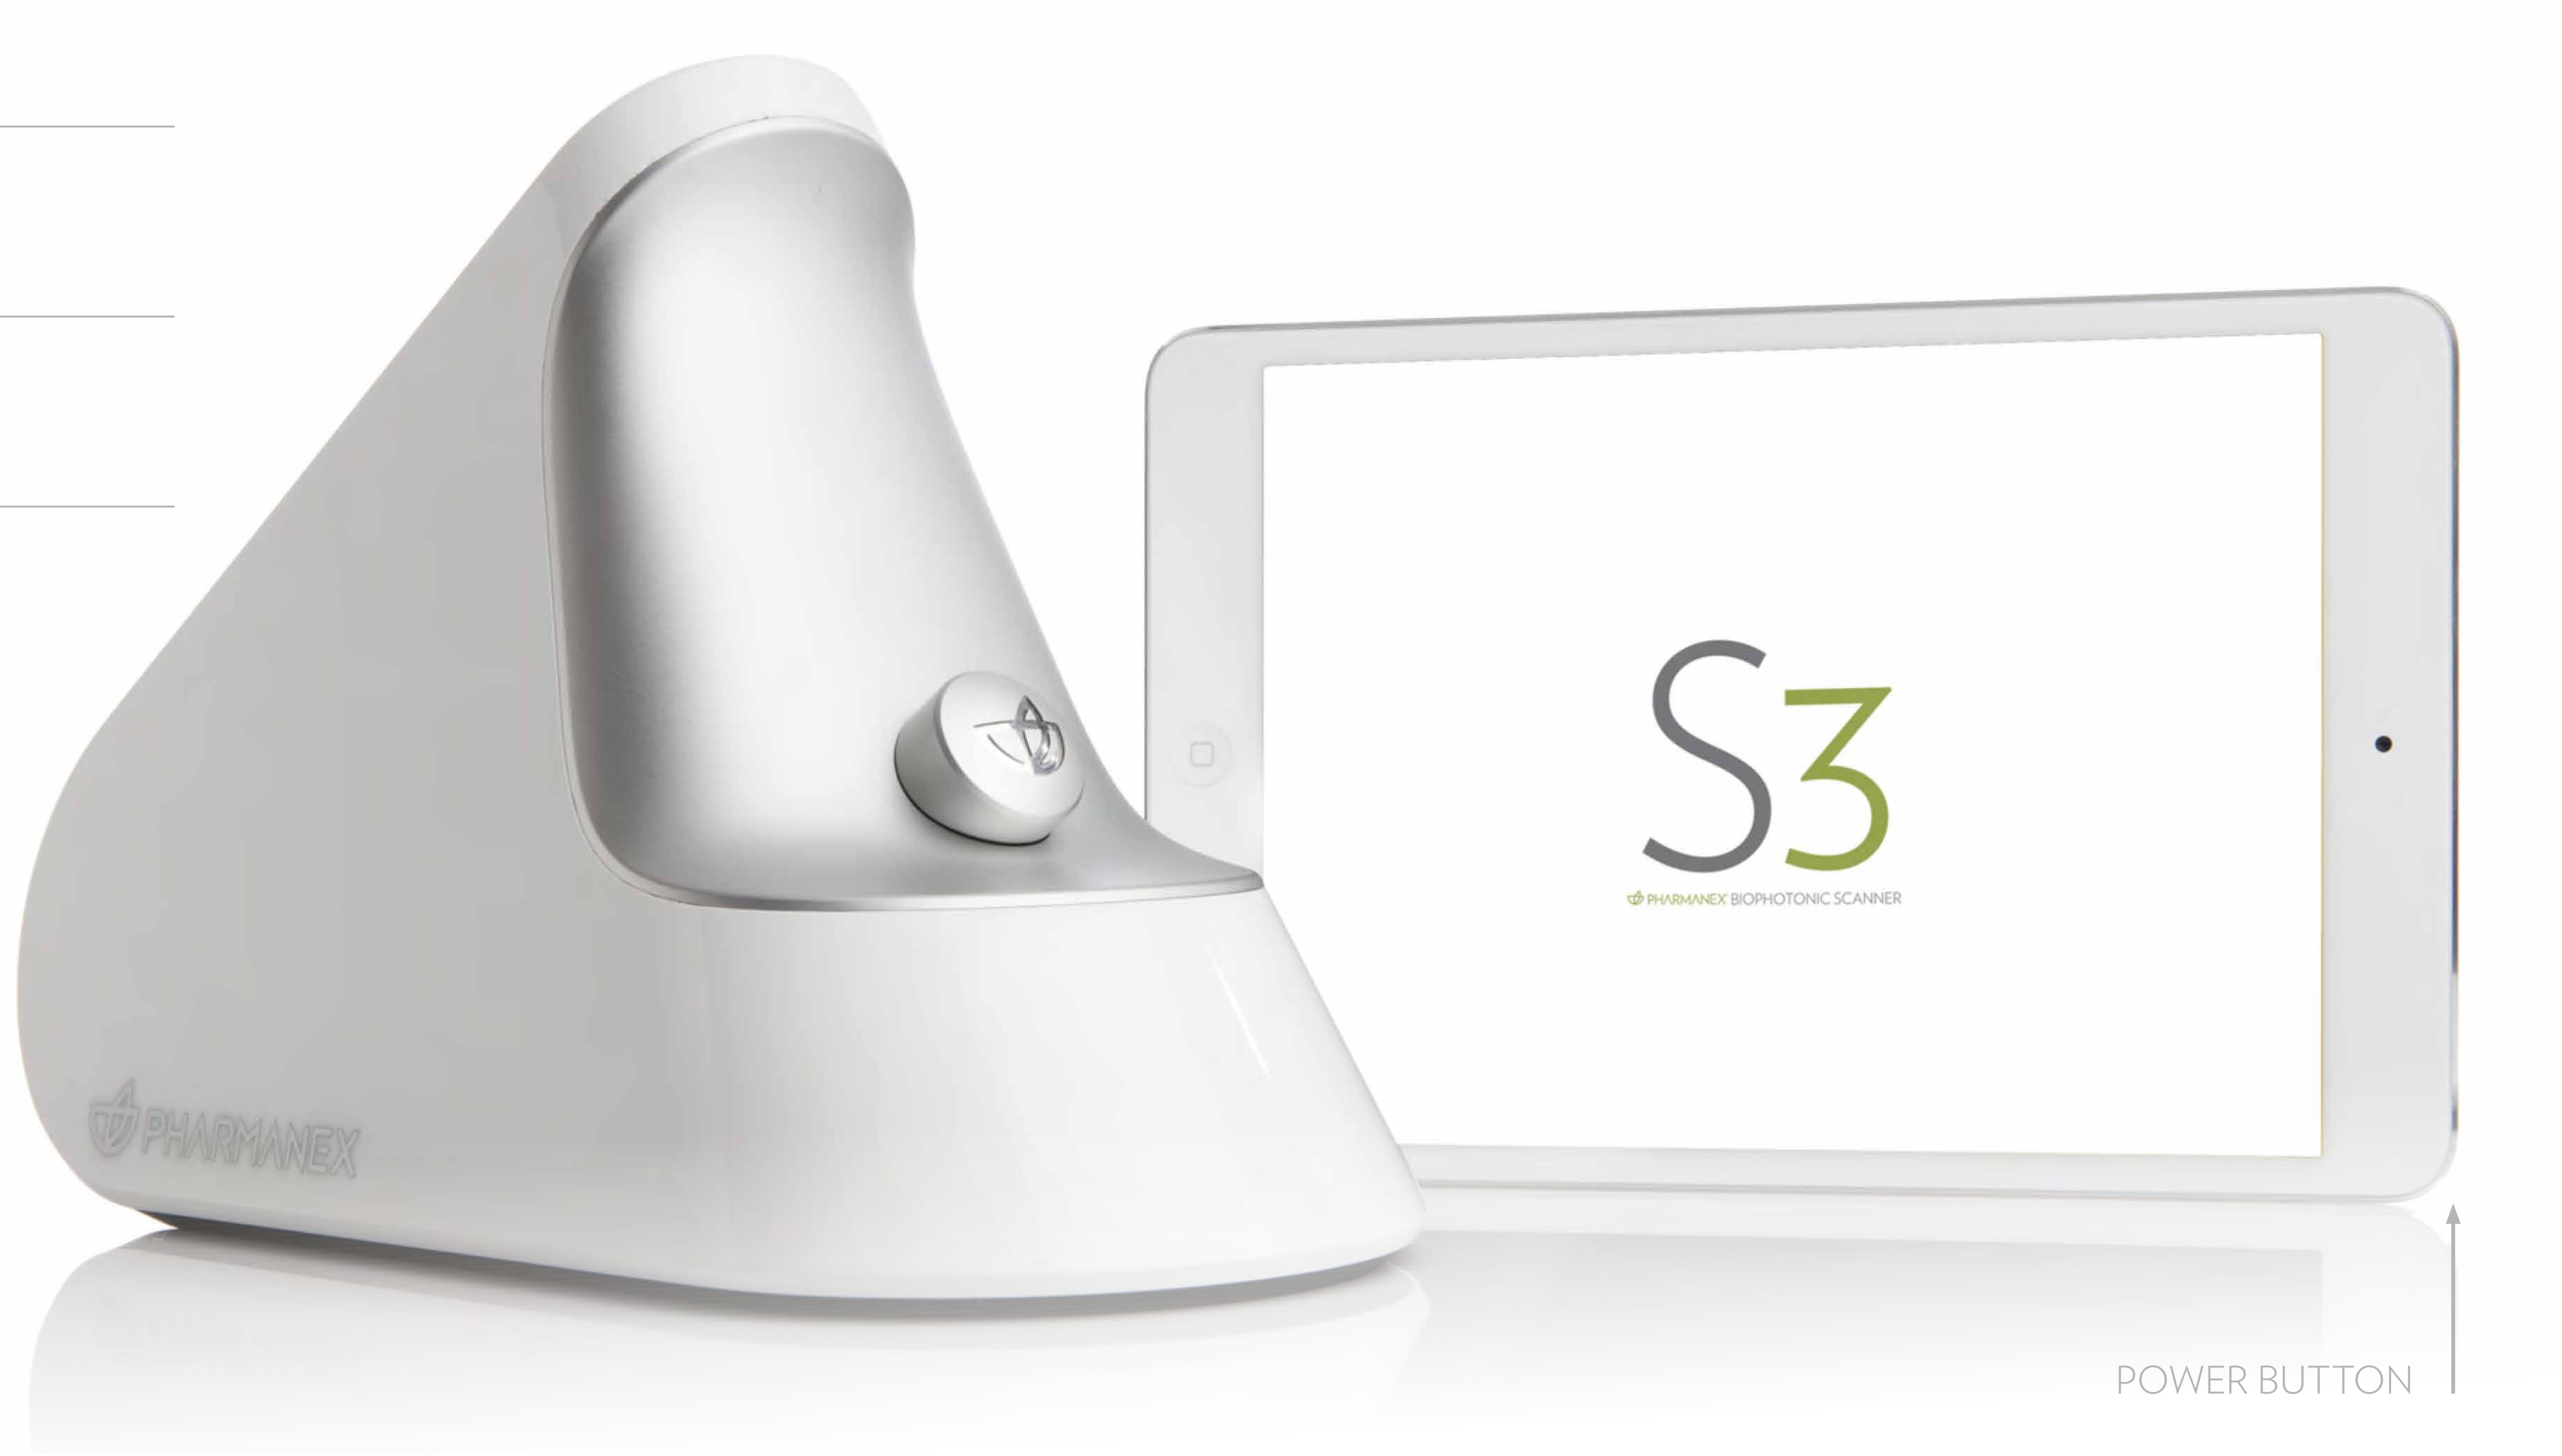
PHARMANEX
S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER
POWER BUTTON

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DAS IPAD MINI MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK VERBINDEN

Ein Drahtlosnetzwerk (WLAN) wird benötigt, um:

- eine Internetverbindung herzustellen.
- die S3 Scanner-App zu installieren. Die S3 Scanner-App muss auf dem iPad mini installiert sein, um den S3 Scanner in Betrieb nehmen zu können.
- Ihre Scandaten mit dem Server von Nu Skin® zu synchronisieren.
- digitale Scancredits zu kaufen.
- die Scanergebnisse per E-Mail an Ihre Kunden zu senden.

Nu Skin Enterprises stellt weder drahtlose Netzwerke noch Support für private oder öffentliche Drahtlosnetzwerke bereit. Sie müssen sich mit Ihrem eigenen Drahtlosnetzwerk verbinden oder auf ein öffentliches Netzwerk zugreifen und die jeweiligen Anmeldeinformationen einholen.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DAS IPAD MINI MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK VERBINDEN

- Wenn das iPad mini aktiviert wurde, wird automatisch der sogenannte Home-Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit hierhin zurückkehren; drücken Sie dazu die „Home“-Taste unten in der Mitte des Gerätes.
- Auf dem Home-Bildschirm befinden sich kleine Symbole. Wenn Sie auf dem Touchscreen auf die Symbole tippen, rufen Sie damit die jeweiligen Computerprogramme, sogenannte „Apps“, auf.
- Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm die App „Einstellungen“.
- Oben links im Fenster dieser App finden Sie die WLAN-Option. Tippen Sie auf diese Option, um Ihre Drahtlosnetzwerk-Einstellungen zu konfigurieren.
- Achten Sie darauf, dass die WLAN-Option aktiviert ist.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DAS IPAD MINI MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK VERBINDEN

- Die verfügbaren drahtlosen Netzwerke werden unten aufgeführt. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk und geben Sie die gegebenenfalls erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

Beispiel:

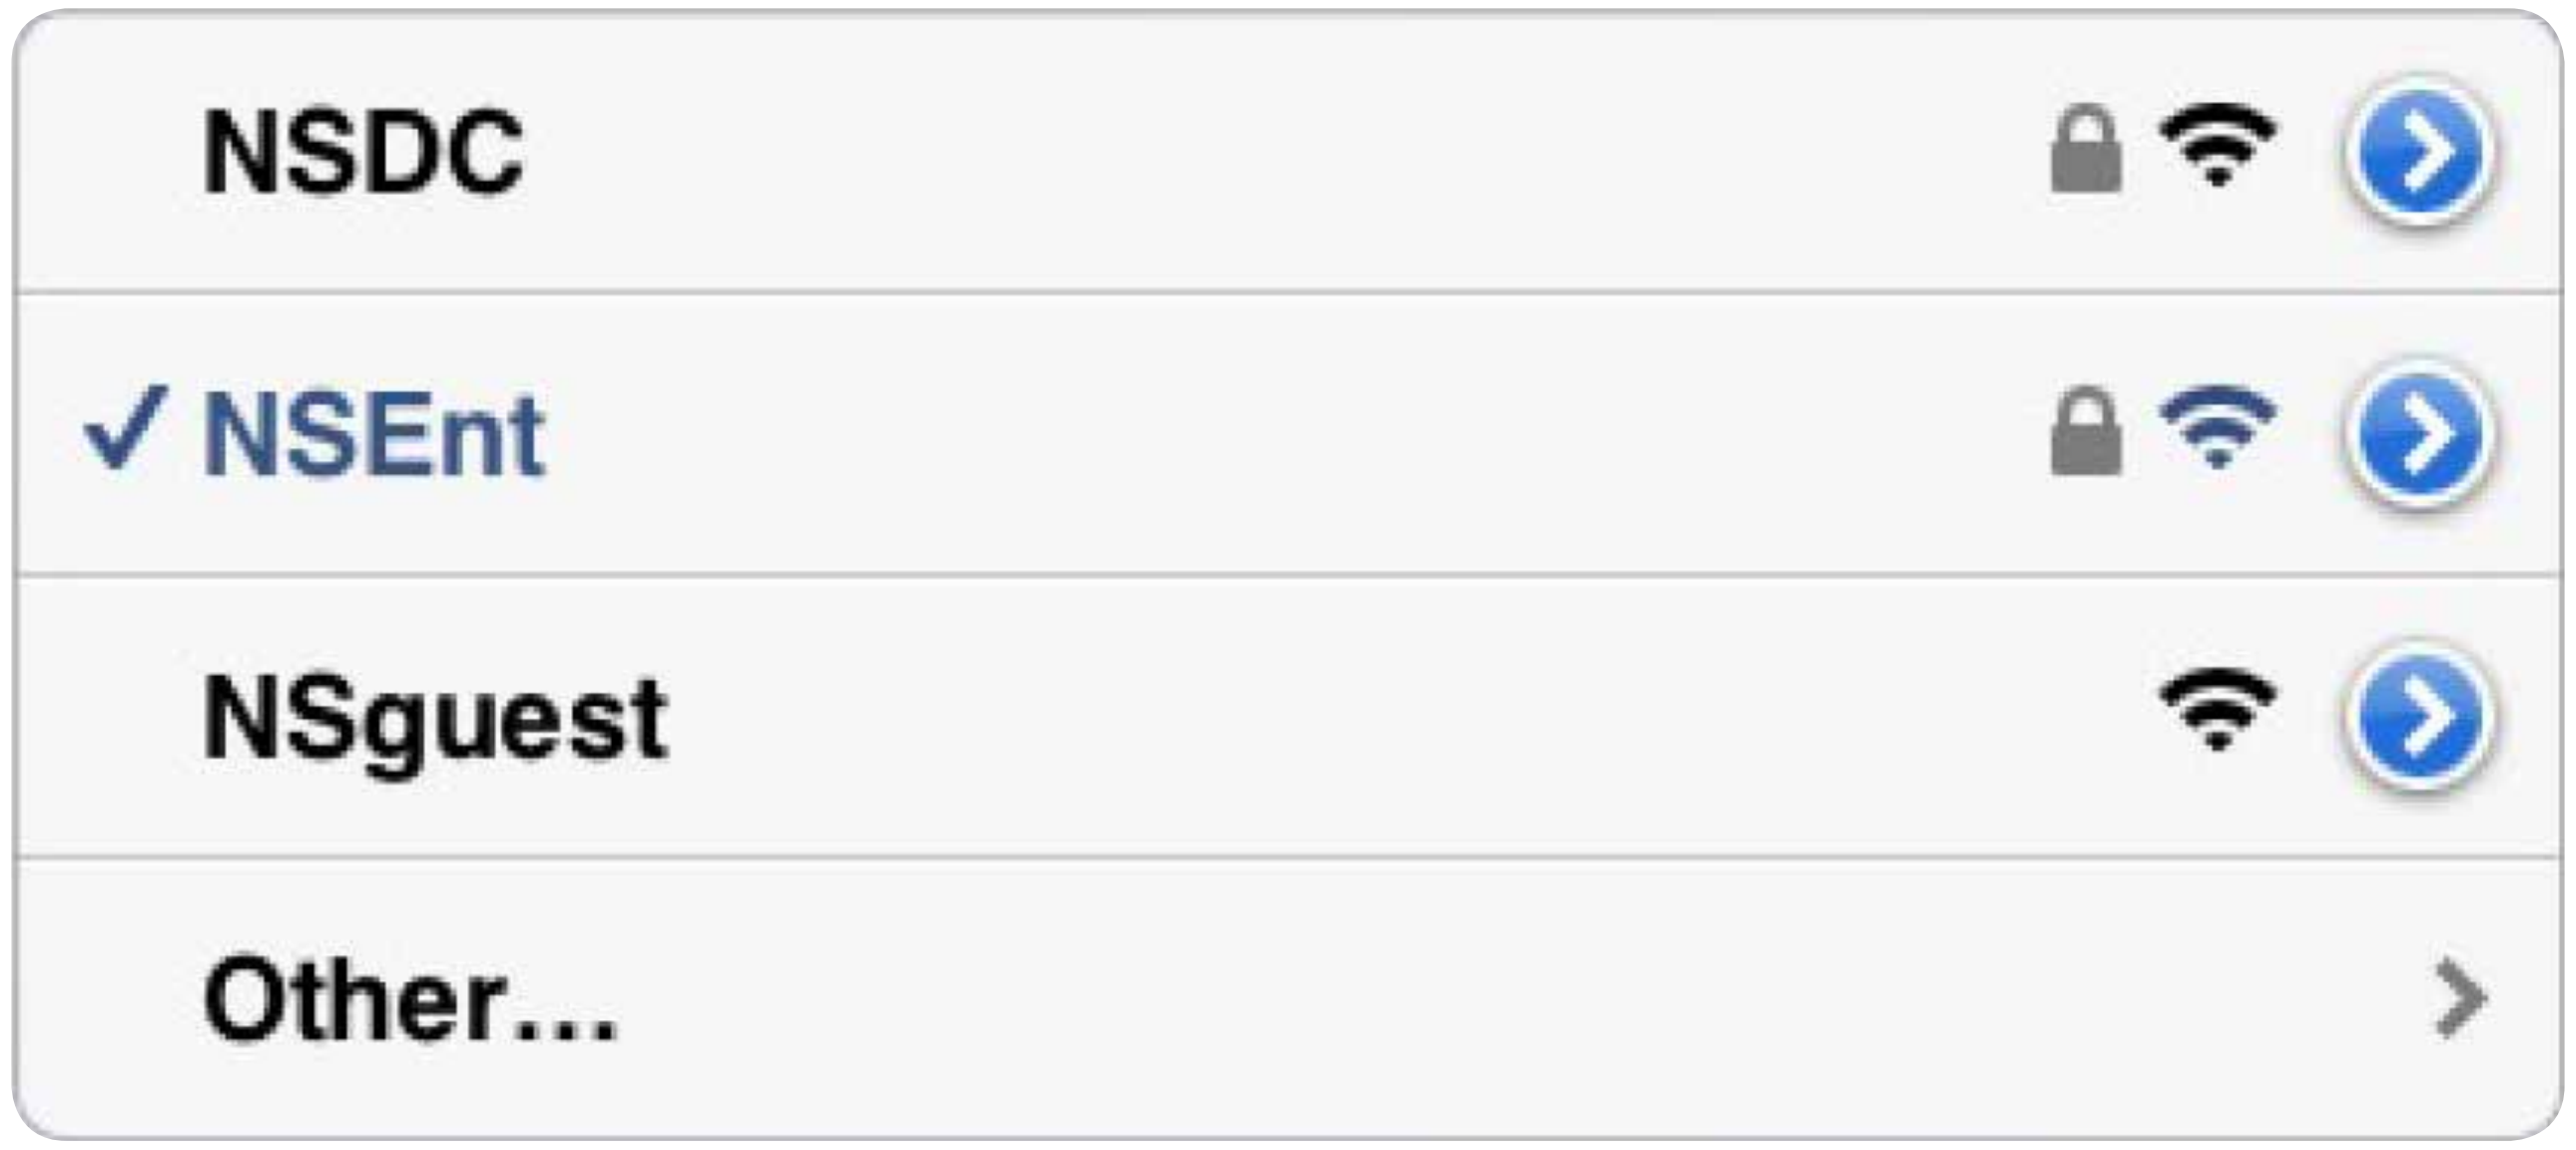

NSDC
✓ NSEnt
NSguest
Other…

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DAS IPAD MINI MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK VERBINDEN

- Wenn Sie ein Netzwerk ausgewählt haben, stellt das iPad mini die Verbindung zum Internet automatisch über dieses Netzwerk her. In der oberen rechten Ecke des Apple Gerätes wird dann das WLAN-Symbol angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
- Das iPad mini versucht automatisch, sich mit Drahtlosnetzwerken zu verbinden, die Sie in der Vergangenheit erfolgreich eingestellt haben, solange Sie sich in Reichweite des entsprechenden Signals befinden. Die Reichweite eines drahtlosen Netzwerks beträgt in der Regel 36 bis 91 m. Störsignale können die Signalreichweite von Drahtlosnetzwerken verringern.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DIE S3 SCANNER-APP AUF DEM IPAD MINI INSTALLIEREN

HINWEIS:
Sie können die S3 Scanner-App erst auf Ihrem iPad mini installieren, wenn das iPad mini mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf die App „Safari“. Geben Sie die Internetadresse ein: **www.s3ScannerApp.com**

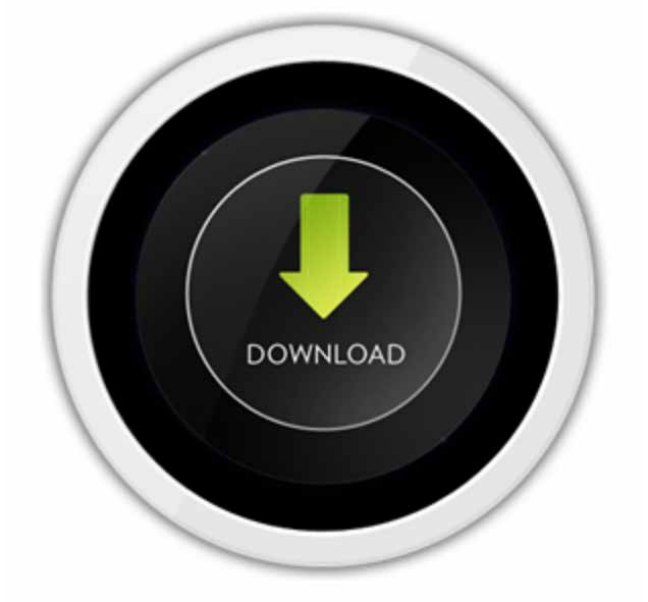

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Download“, um die S3 Scanner-App herunterzuladen.

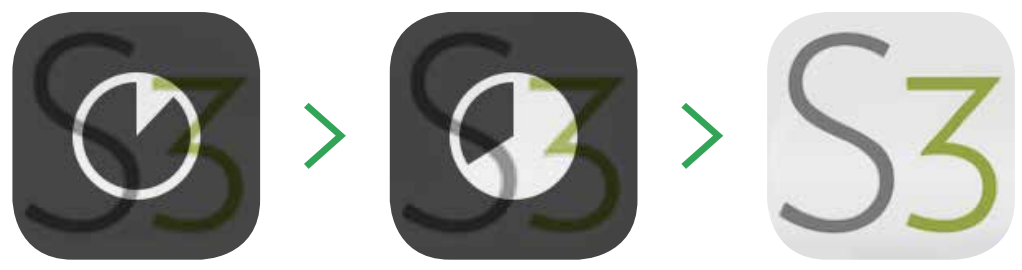

Nach dem erfolgreichen Installieren der S3 Scanner-App auf dem iPad mini wird das Symbol zur App auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol der S3 Scanner-App, um das Programm aufzurufen.

Sie können jederzeit die Home-Taste drücken, um die S3 Scanner-App zu beenden.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

HINWEIS:
Der S3 wird mit einem Akku betrieben. Sobald der Akku geladen ist, kann das Gerät von der Stromversorgung getrennt und als eigenständiges Gerät bis zu 6 Stunden im Dauerbetrieb verwendet werden.

WICHTIGER HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass sich die Dunkelkappe auf der Linse des S3 befindet, bevor Sie das Gerät einschalten. Der S3 wird erst vollständig aktiviert, wenn das Gerät die Dunkelkappe erkennt. Sitzt die Dunkelkappe fest auf der Linse, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den S3 einzuschalten. Auf dem Display des S3 wird angezeigt, dass das Gerät eingeschaltet und bereit ist, sich mit dem iPad mini zu verbinden.

WEITER >

AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
GERÄTE LADEN
IPAD MINI AKTIVIEREN
IPAD VERBINDEN
S3 APP INSTALLIEREN
ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

Drücken Sie die Home-Taste am iPad mini, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie auf die App „Einstellungen“, um zu den Einstellungen des iPads zu gelangen. Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet werden. Das iPad mini erkennt nun Bluetooth-Signale. Drücken Sie wieder die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Auf der Rückseite des S3 Scanners befindet sich rechts neben der Ein/Aus-Taste die Bluetooth-Taste. Halten Sie die Bluetooth-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte zu blinken beginnt. Die blinkende blaue LED-Leuchte auf der Rückseite des S3 zeigt an, dass das Gerät nun ein Bluetooth-Signal überträgt. Wenn Sie den Scanner das nächste Mal einschalten, müssen Sie die Bluetooth-Taste nicht noch einmal drücken. Für nachfolgende Verbindungen ist dieser Schritt nicht mehr erforderlich.

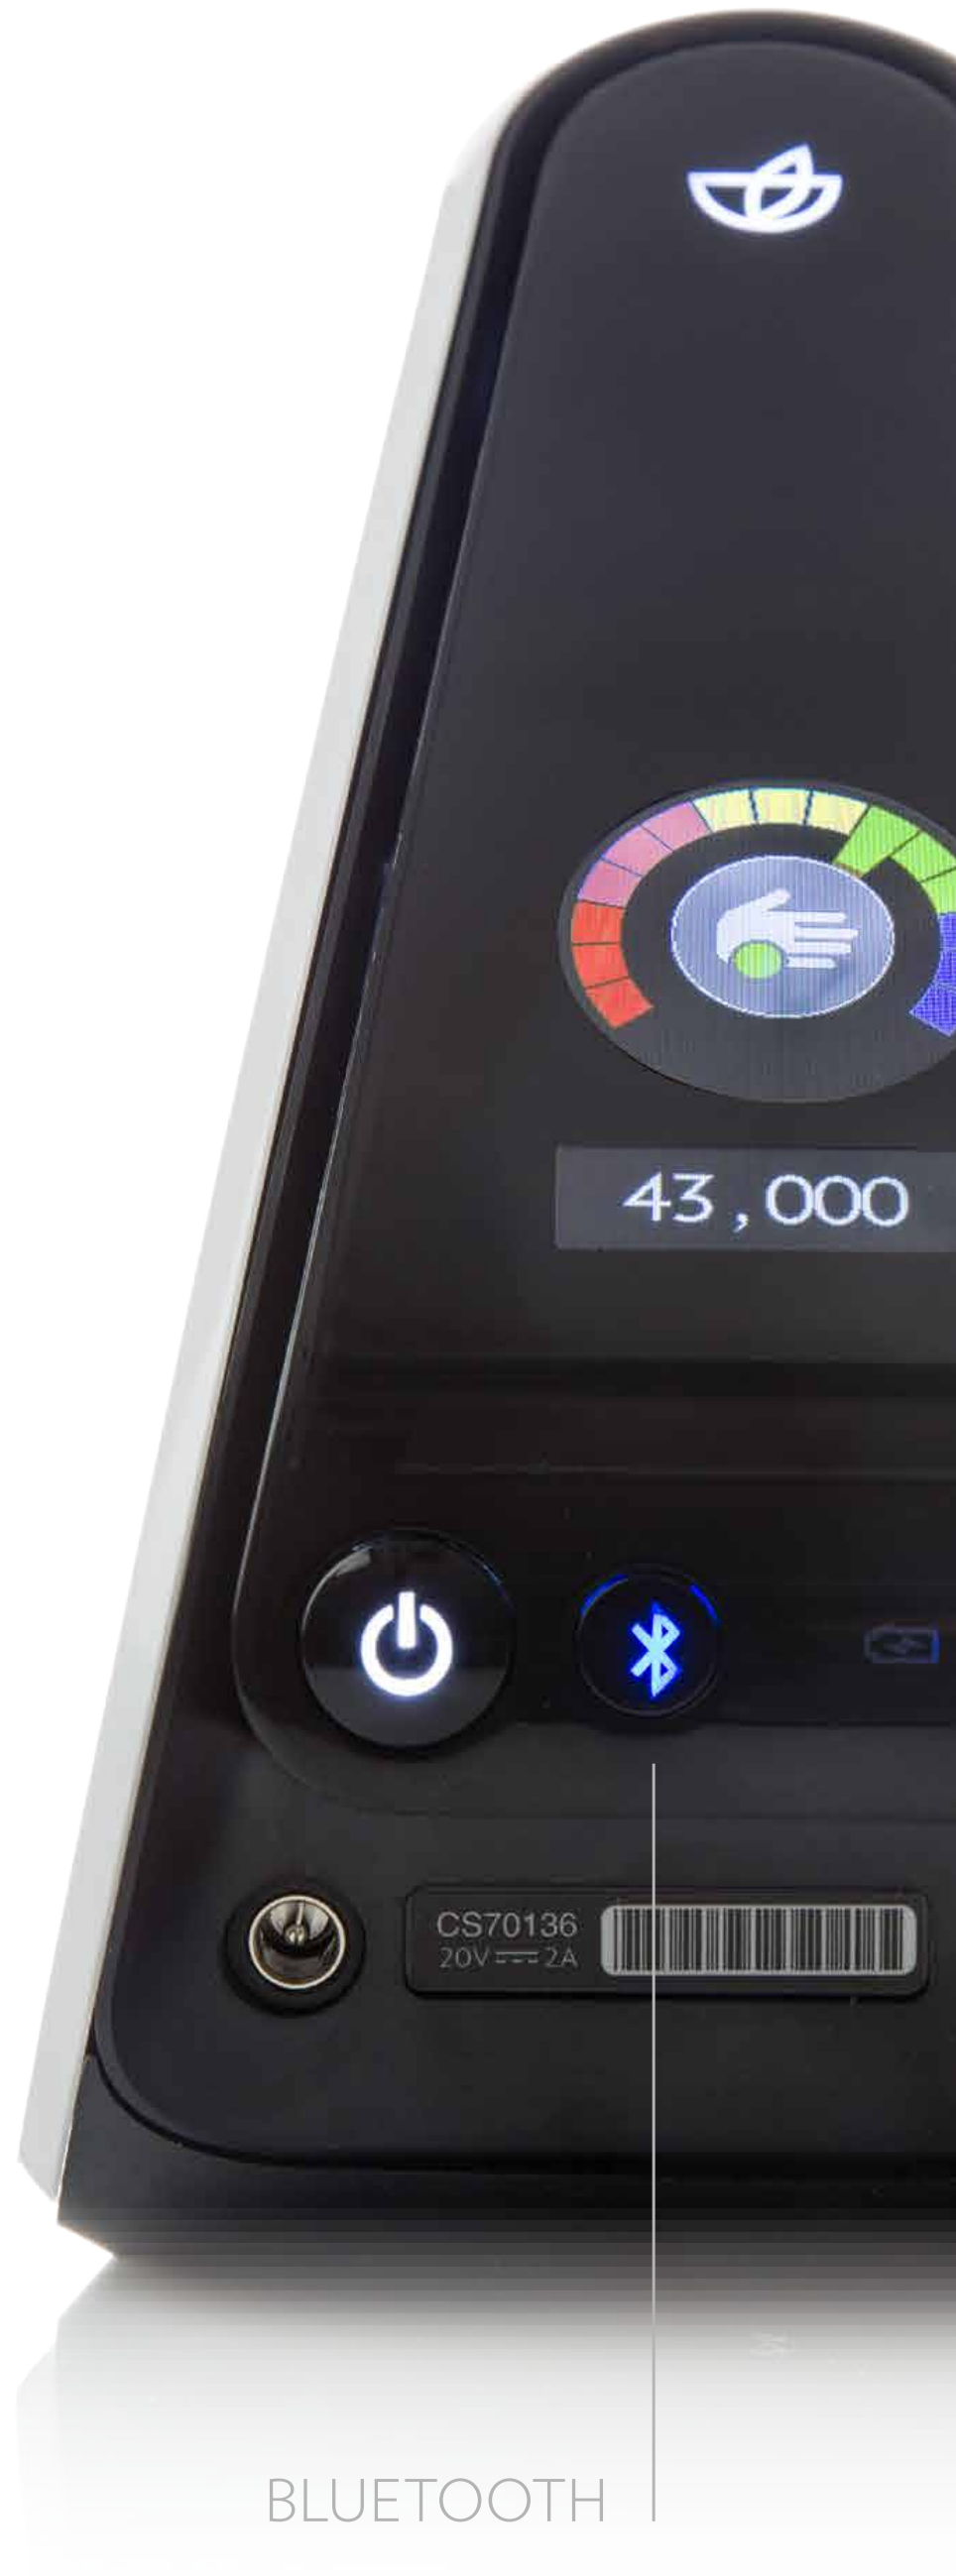

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

SO GEHT'S:

Tippen Sie auf die S3 Scanner-App. Rufen Sie die S3 Scanner-App erst auf, wenn die Bluetooth-Taste blinkt.

- Ziehen Sie im Tab „Status“ die Pfeile unter der Schaltfläche „Auf Pfeile klicken, um nach Scannern zu suchen“ nach unten.

  Die App sucht jetzt nach S3 Bluetooth-Signalen. Wird Ihr S3 nicht aufgeführt, ziehen Sie die Pfeile erneut nach unten. Störsignale können gelegentlich dazu führen, dass der Scanner im ersten Suchlauf nicht erkannt wird. Erkannte S3 Geräte werden im Status-Fenster links aufgeführt.

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

SO GEHT'S:

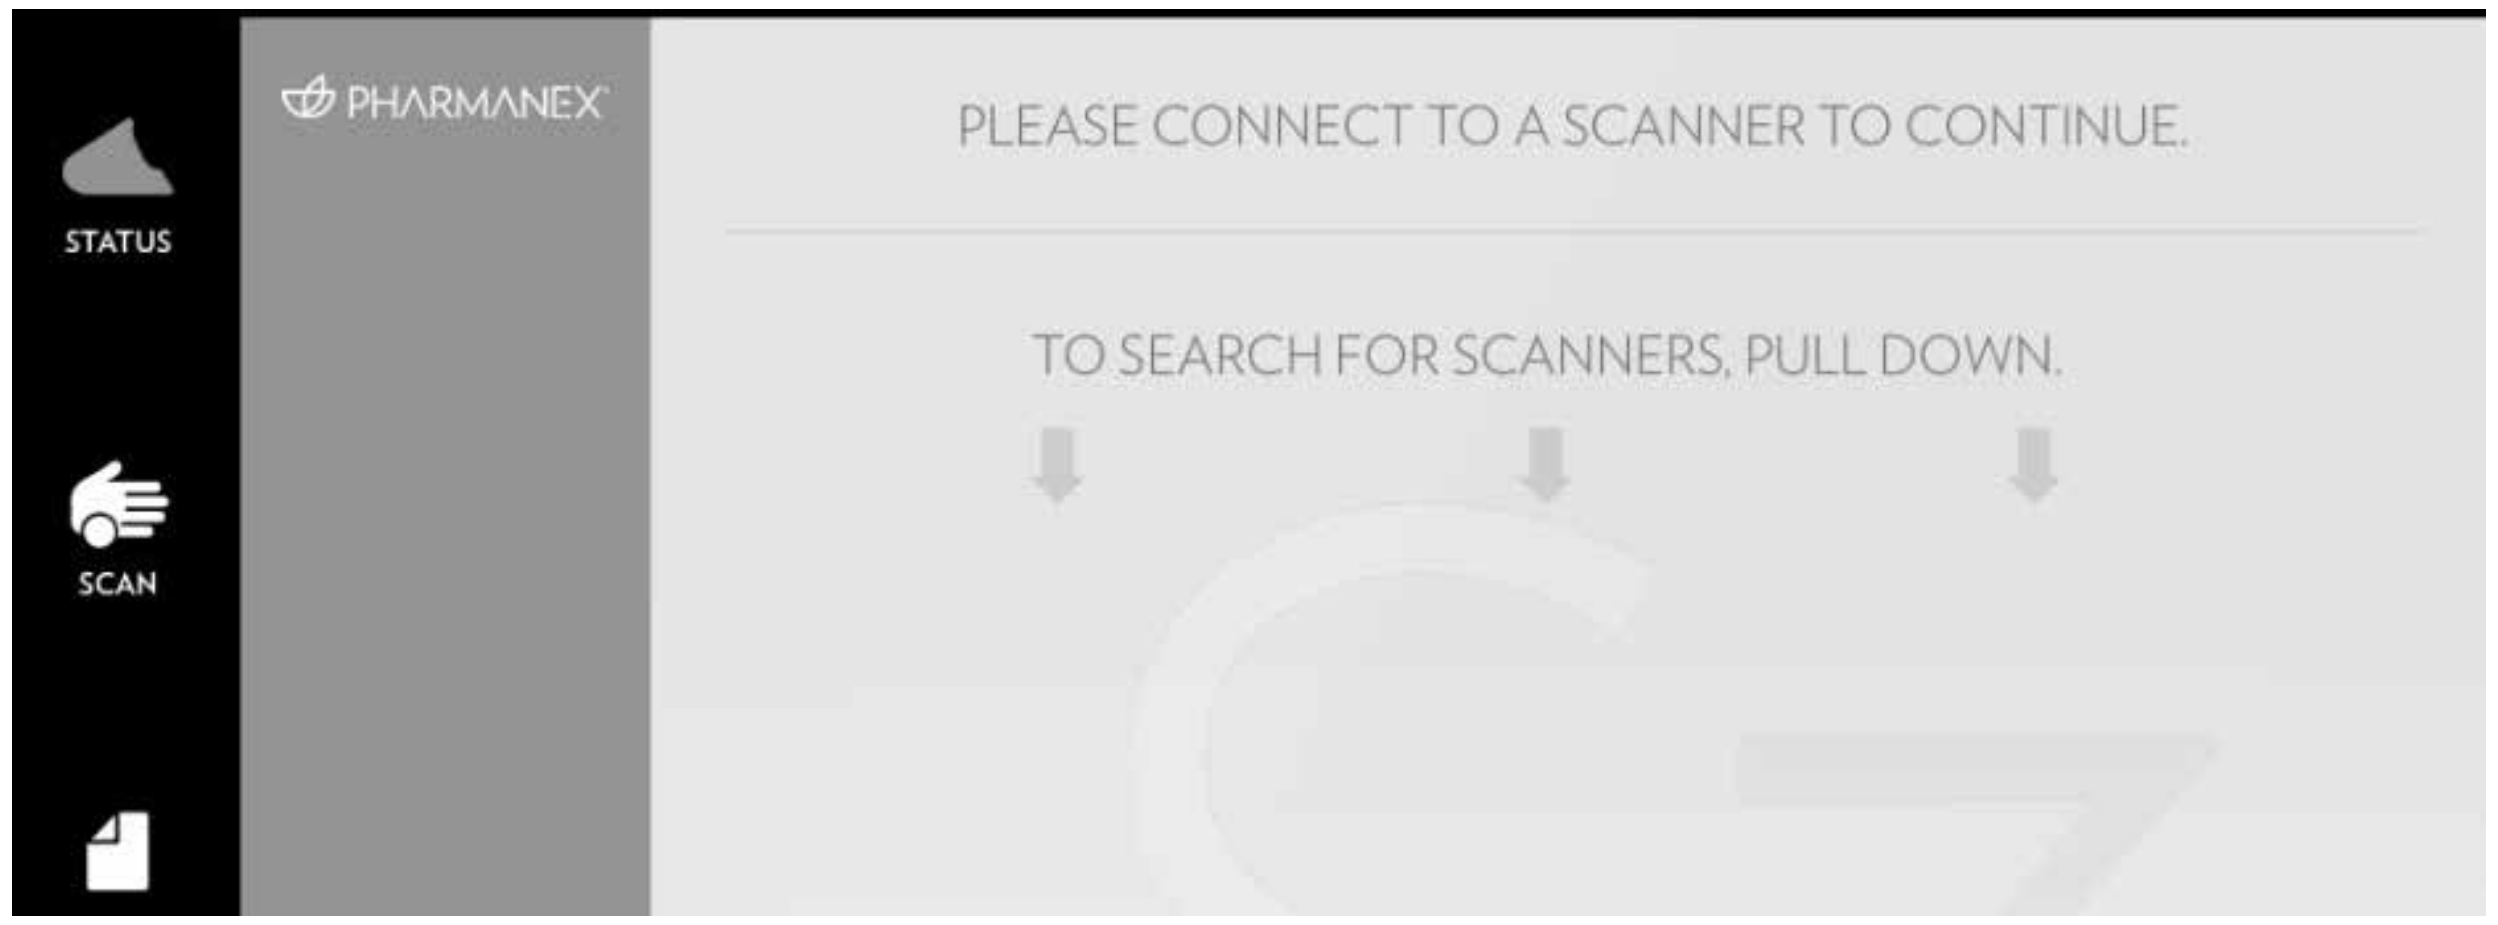

PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- Tippen Sie auf die CS-Nummer Ihres S3.

  Ein Fenster wird mit der Frage angezeigt, ob Sie sich mit dem Scanner verbinden möchten.

- Klicken Sie auf „Ja".

  Die Geräte werden nun miteinander verbunden.

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

SO GEHT’S:

Sobald ein S3 mit dem iPad mini verbunden ist, werden die eingeschalteten Geräte automatisch versuchen, sich gegenseitig zu erkennen und miteinander zu kommunizieren – so lange, bis Sie im Tab „Status“ die Option „Getrennt“ wählen.

> WICHTIG:
> Mit dem iPad mini kann jeweils nur ein S3 verbunden sein.

WEITER >

- AUSSTATTUNGSLISTE PRÜFEN
- GERÄTE LADEN
- IPAD MINI AKTIVIEREN
- IPAD VERBINDEN
- S3 APP INSTALLIEREN
- ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

DEN SCANNER EINSCHALTEN UND MIT DEM IPAD MINI ÜBER BLUETOOTH VERBINDEN

Die Übertragung per Bluetooth unterscheidet sich von der über ein WLAN. Mit einem WLAN kann ein Gerät eine Internetverbindung herstellen. Bei Bluetooth handelt es sich hingegen um eine lokale Signalübertragung zwischen zwei Geräten. Solange die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, können Ihr S3 und das iPad mini miteinander kommunizieren, auch wenn Sie keine WLAN-Verbindung haben.

Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten beträgt maximal ungefähr 50 m. Störsignale von verschiedenen Quellen können diese Reichweite einschränken. Im Tab „Status“ Ihrer S3 Scanner-App sehen Sie, ob Sie sich außerhalb der Reichweite befinden und die Verbindung zu Ihrem S3 verloren haben.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „STATUS“ UND DIE S3 KALIBRIERUNG

Im Tab „Status“ werden der Status des Scanners angezeigt und die Scans zur Kalibrierung durchgeführt: Dunkelkappen- und Operator-Scans. S3 Scanner werden wie folgt anzeigt:

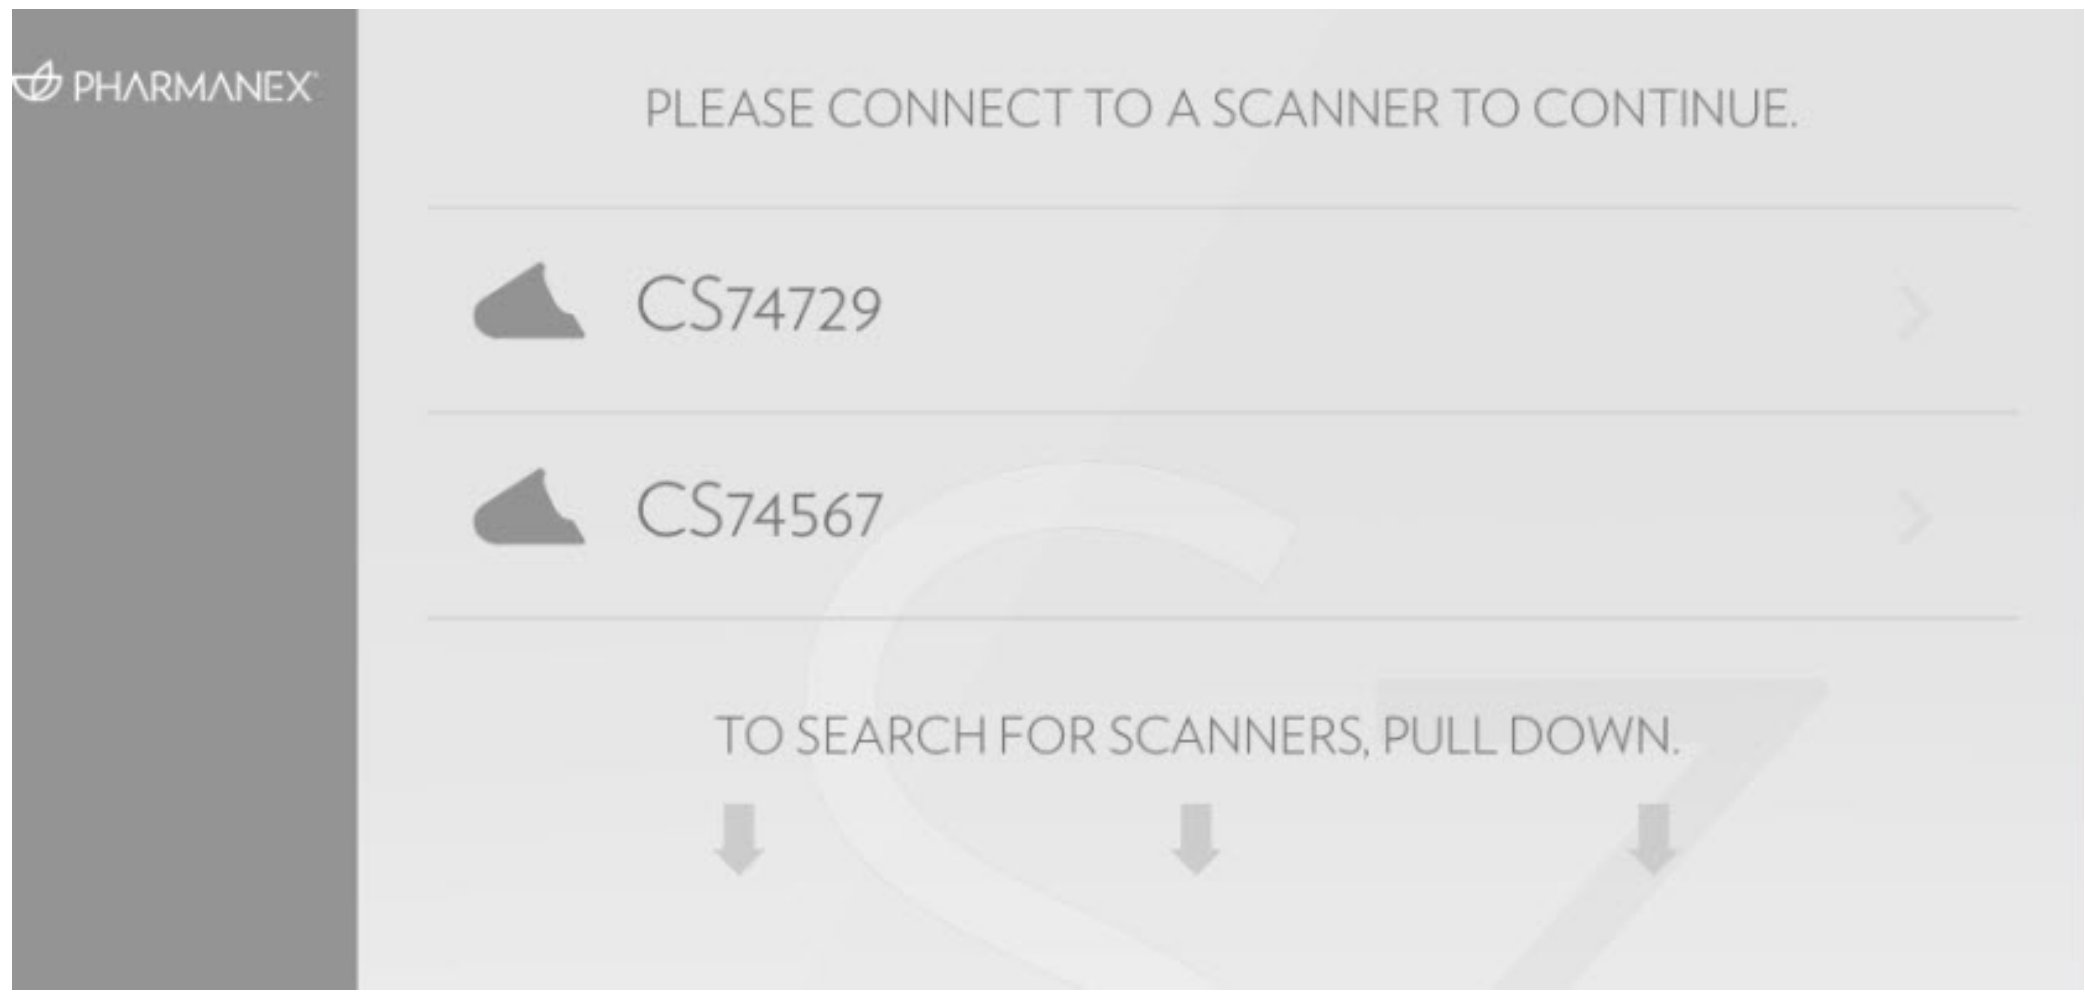

PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

CS74729

CS74567

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- In Reichweite, graues S3 Symbol

HINWEIS:
Sollte Ihr Scanner „gesperrt“ sein und eine Meldung erscheinen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Scannerservice.

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „STATUS“ UND DIE S3 KALIBRIERUNG

HINWEIS:
Es kann nur jeweils ein S3 mit dem iPad Mini verbunden sein.

Wenn ein S3 mit der Scanner-App verbunden ist, werden im Tab „Status“ die CS-Nummer angezeigt.

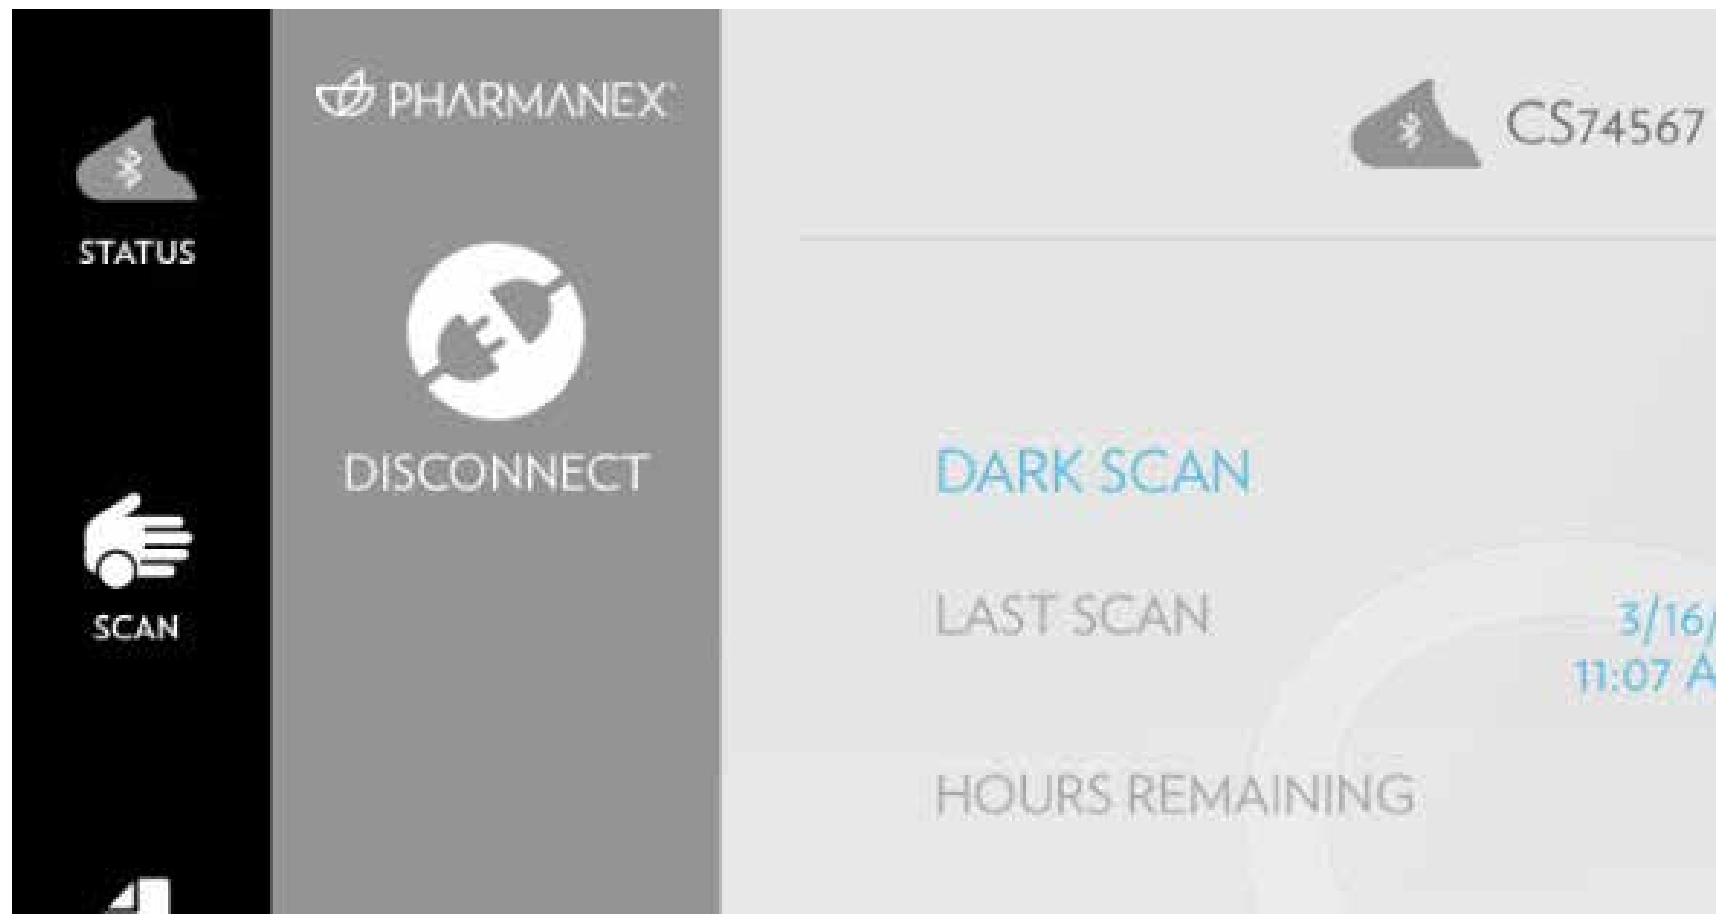
STATUS
SCAN
PHARMANEX
DISCONNECT
CS74567
DARK SCAN
LAST SCAN
3/16/
11:07 A
HOURS REMAINING

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „STATUS“ UND DIE S3 KALIBRIERUNG

Der nächste Schritt ist der Dunkelkappenscan. Vergewissern Sie sich, dass sich die Dunkelkappe auf der Linse des S3 befindet, und tippen Sie auf das Dunkelscansymbol. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen bis zum Ende des Dunkelscanvorgangs. Ein Dunkelkappenscan muss alle 24 Stunden durchgeführt werden.

Entfernen Sie danach die Dunkelkappe und führen Sie einen Operator-Scan durch. Tippen Sie dazu auf das Operator-Scansymbol. Einen Operator-Scan müssen Sie alle 14 Tage durchführen.

Mit diesen Kalibrierungsscans wird eine konstante Funktionalität des Scanners sichergestellt. Achten Sie daher darauf, die Scans immer regelmäßig durchzuführen.

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

WICHTIGER HINWEIS:
Bevor Sie eine Person scannen, müssen Sie deren ausdrückliche Zustimmung zur Erfassung ihrer persönlichen Daten, wie Name und demografische Angaben, erhalten haben. Lassen Sie die Person dazu Anhang B Ihrer S3 Vereinbarung unterschreiben und bewahren Sie die Kopie in Ihren Unterlagen auf. Nu Skin® führt regelmäßig Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass Sie diese Formulare aufbewahren.

Um eine Person zu scannen, müssen Sie entweder digitale Scancredits kaufen oder eine Scankarte verwenden.

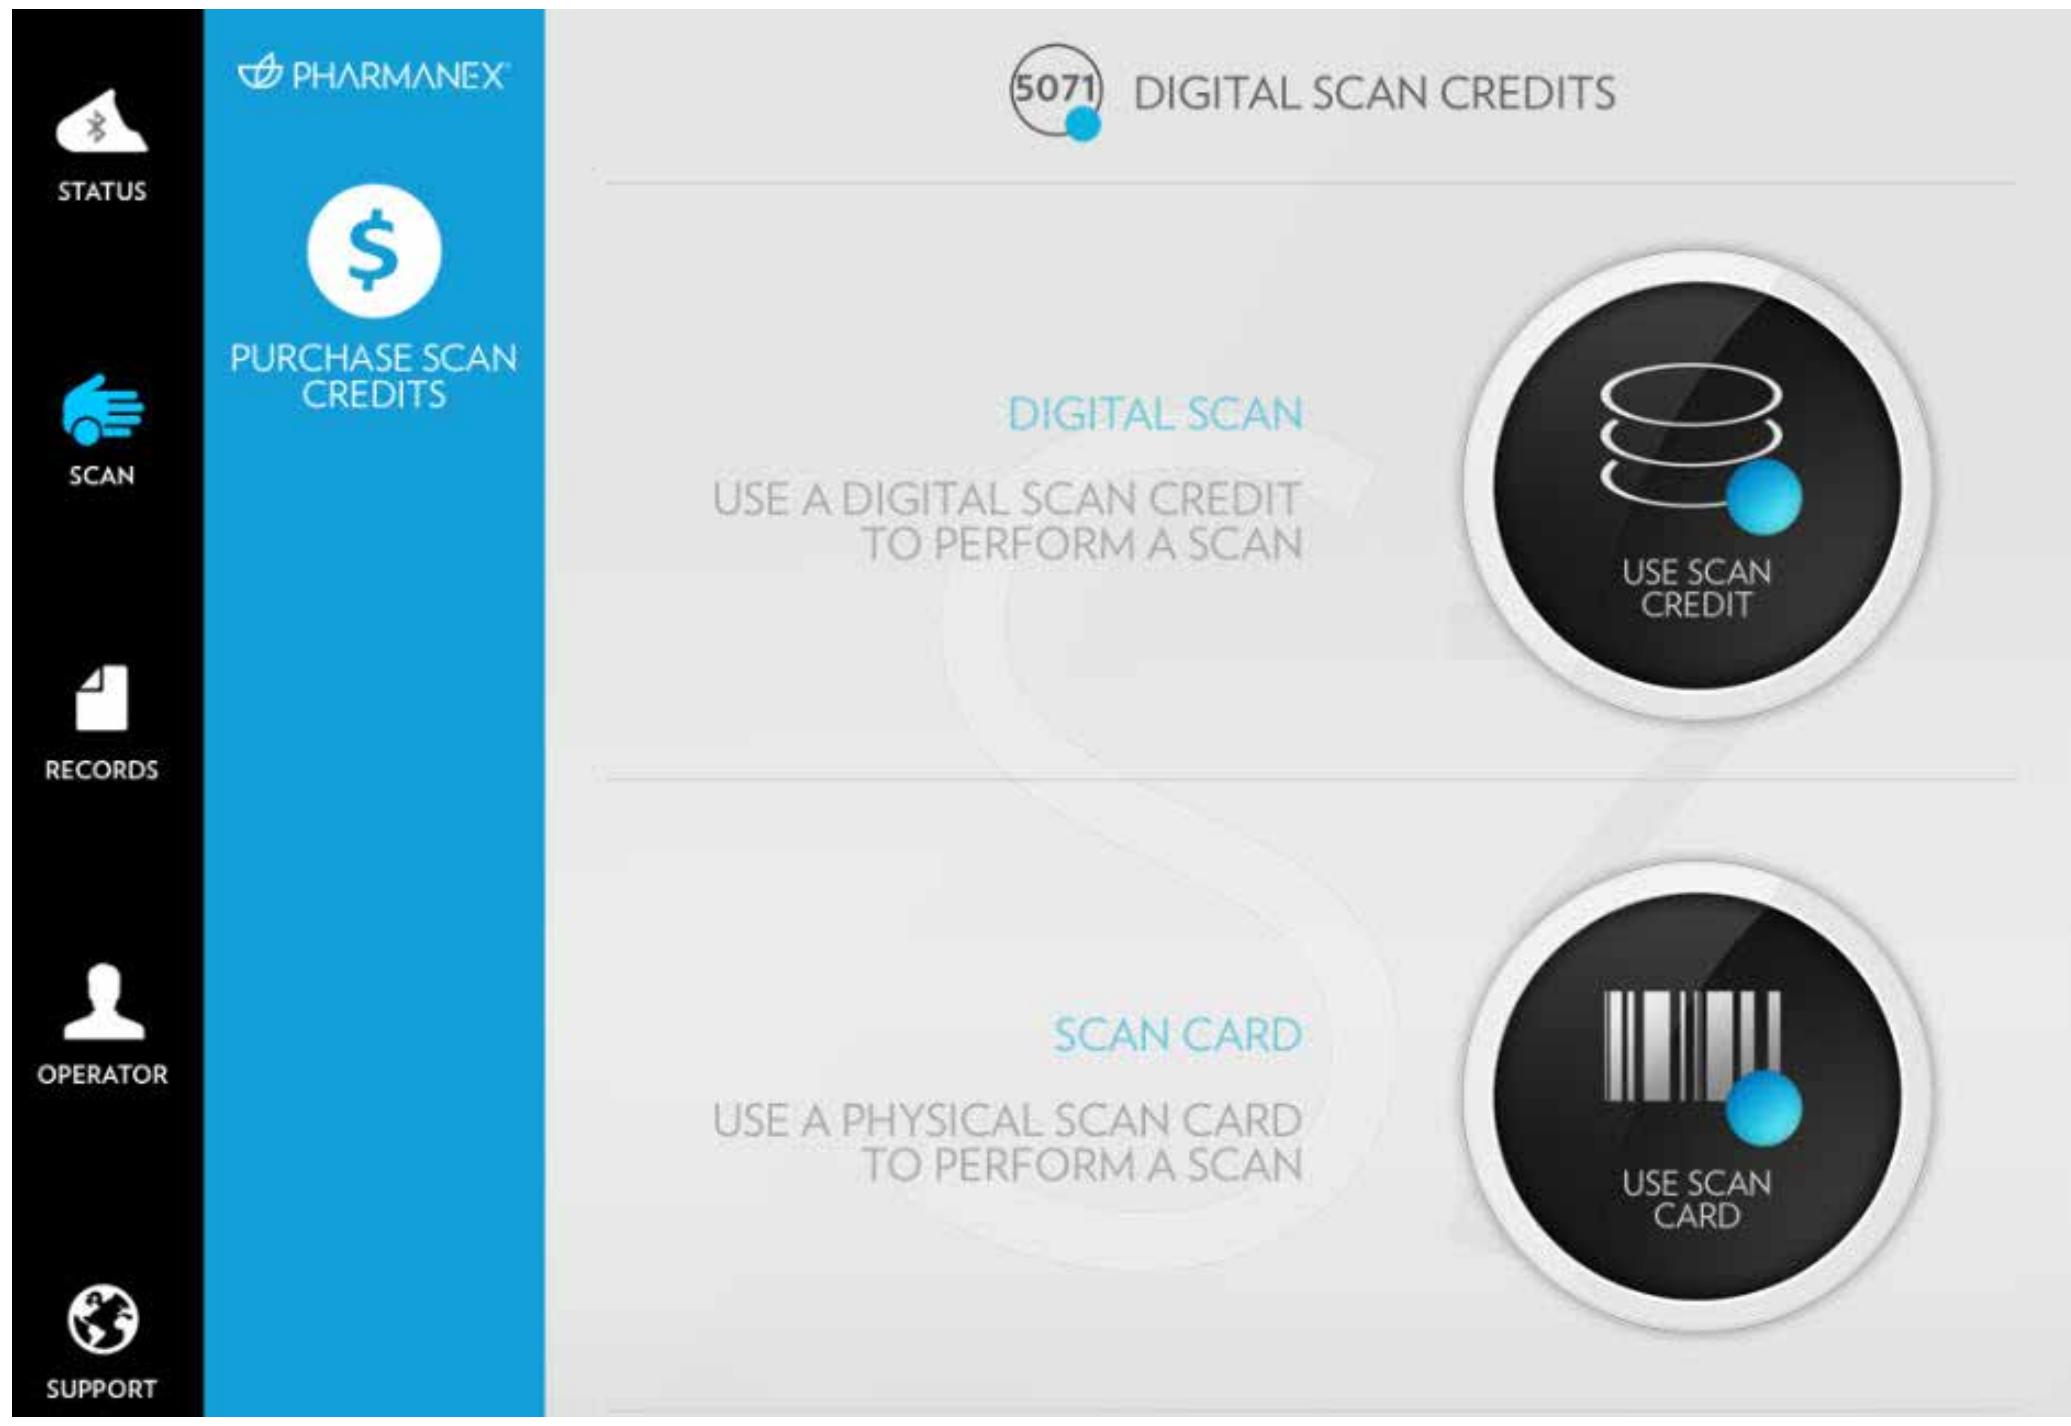
STATUS
SCAN
RECORDS
OPERATOR
SUPPORT
PHARMANEX
PURCHASE SCAN CREDITS
5071
DIGITAL SCAN CREDITS
DIGITAL SCAN
USE A DIGITAL SCAN CREDIT TO PERFORM A SCAN
USE SCAN CREDIT
SCAN CARD
USE A PHYSICAL SCAN CARD TO PERFORM A SCAN
USE SCAN CARD

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

A. SCANNEN MIT DIGITALEN SCANCREDITS

Credits kaufen

SO GEHT’S:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Scancredits kaufen“.

  Sie werden in einem neuen Fenster gebeten, sich bei Ihrem Vertriebspartner-Account anzumelden. Bitte halten Sie Ihre Vertriebspartner-ID, Ihre Anmeldeinformationen zum Einloggen auf der Nu Skin® Webseite und eine Kreditkarte bereit. Um den Kauf durchzuführen, muss das iPad mini mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sein.

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

Sie können Scancredits in 1er-, 20er- oder 100er-Mengen kaufen. Tippen Sie dazu auf die entsprechenden Symbole auf dem Bildschirm.

- Wenn Sie die gewünschte Anzahl an Credits ausgewählt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Zur Kasse“, um die Credits zu kaufen und Ihrem S3 hinzuzufügen.

  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen bis zum Ende des Kaufvorgangs.

- Wenn Sie fertig sind, können Sie das Fenster zum Kauf digitaler Scancredits schließen. Tippen Sie dazu auf das Symbol „Zurück“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

  So kehren Sie zum Tab-Fenster „Scan“ zurück.

WEITER ›

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

HINWEIS:
Nach dem Kauf von Scancredits werden Sie feststellen, dass sich sowohl das Symbol des Tabs „Scan“ als auch das Symbol „Digitaler Scan“ geändert haben. Beide Symbole enthalten nun Zahlen, die anzeigen, wie viele digitale Scans Sie noch haben. Behalten Sie diese Zahl im Auge, um zu sehen, wann Sie neue Scancredits nachkaufen müssen!

Digital scannen

Wenn noch Scancredits übrig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche „Digitaler Scan“. Damit werden Sie automatisch durch den Scanvorgang geführt.

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

B. SCANNEN MIT EINER SCANKARTE

SO GEHT'S:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Scankarte“. Dann können Sie entweder eine Scankarte mit der Kamera des iPad mini einlesen oder die Scankartennummer über die digitale Tastatur eingeben.

  Wenn die Scankarteninformationen erfasst wurden, werden Sie von der S3 Scanner-App durch den Scanvorgang geführt.

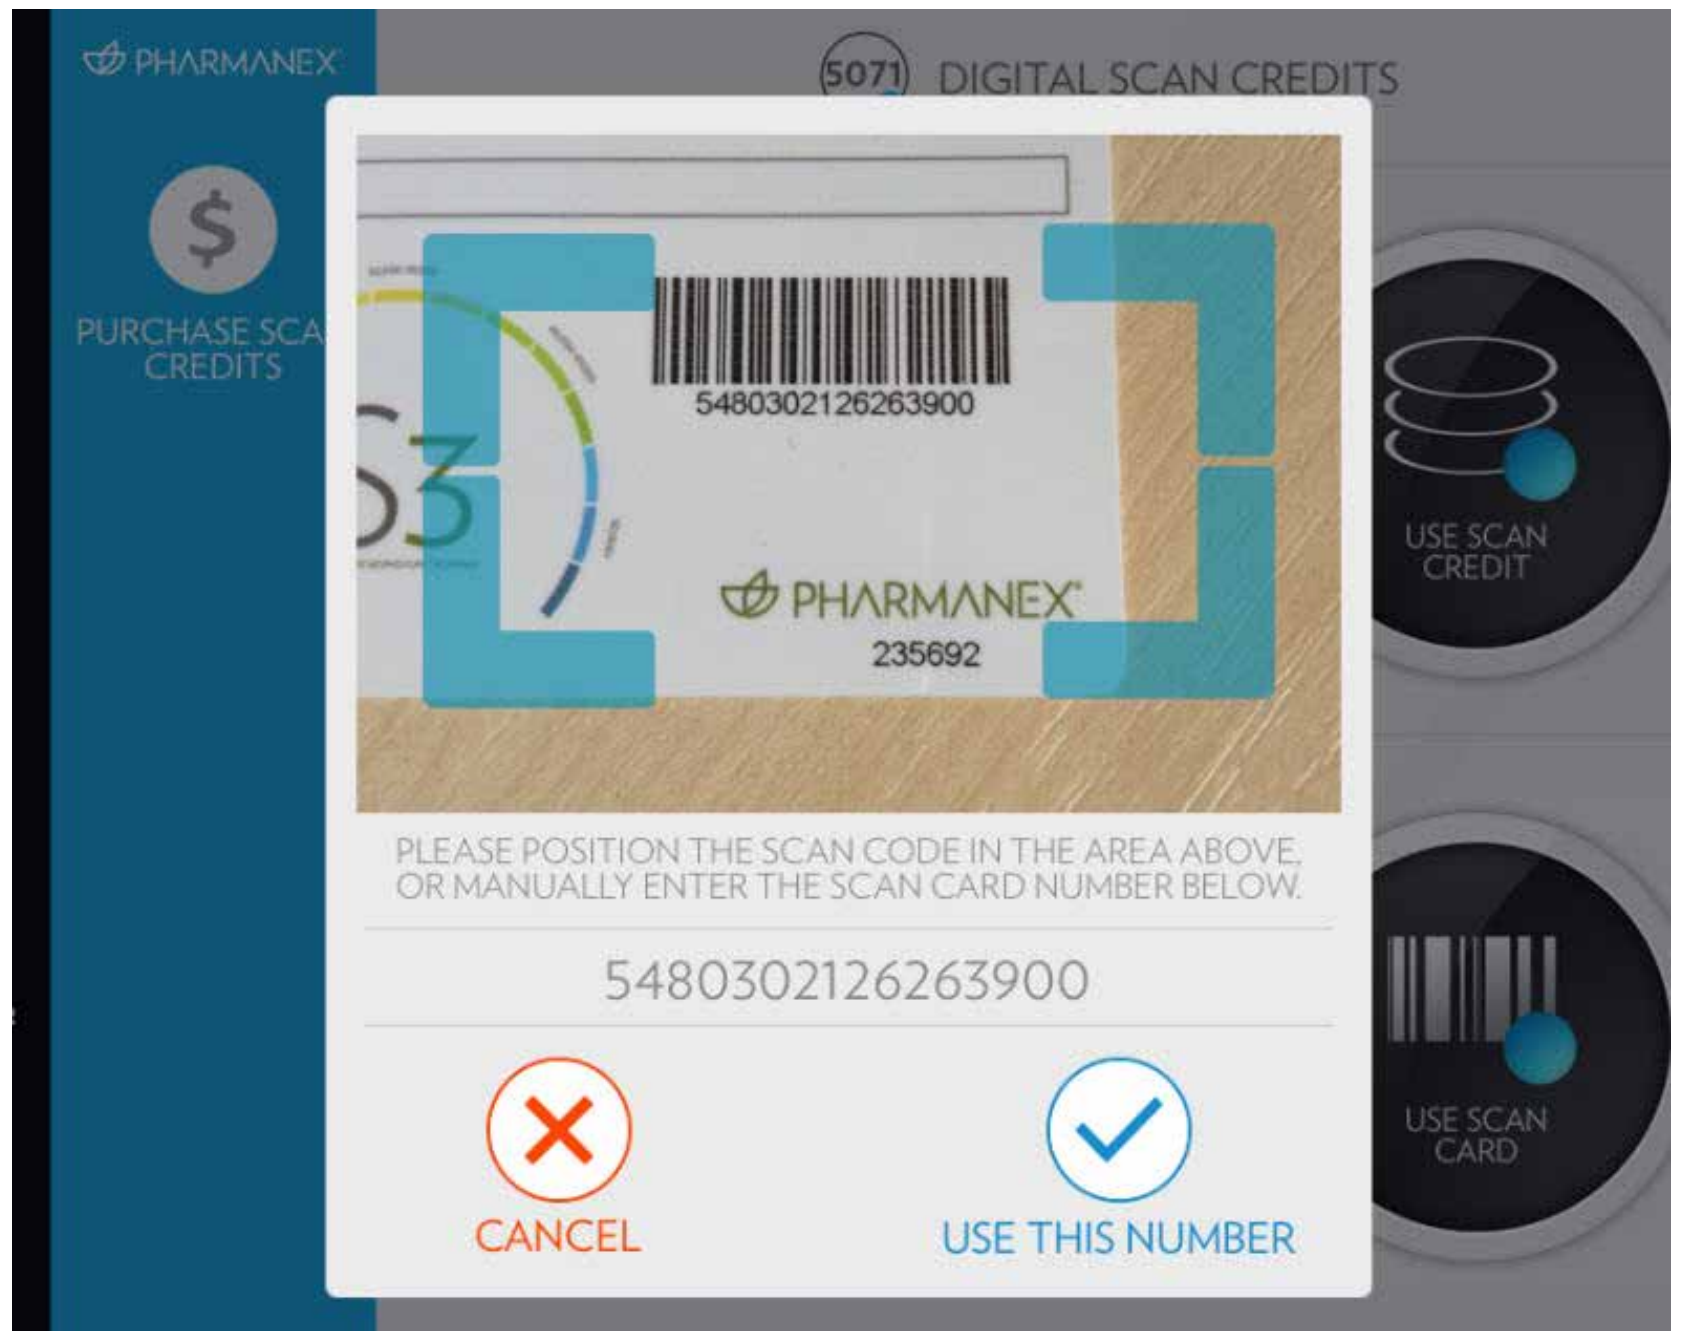
PHARMANEX
5071 DIGITAL SCAN CREDITS
PURCHASE SCAN CREDITS
5480302126263900
PHARMANEX
235692
USE SCAN CREDIT
USE SCAN CARD
CANCEL
USE THIS NUMBER

PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE, OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

5480302126263900

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

- Die Kameralinse befindet sich auf der Rückseite des iPad mini in der oberen linken Ecke direkt unter der Standbytaste.

> WICHTIG:
> Achten Sie beim Einlesen des Strichcodes einer Scankarte darauf, die Kameralinse nicht versehentlich zu verdecken. Am besten halten Sie das iPad mini bei der Bildaufnahme mit den Händen sowohl links als auch rechts an den Ecken fest, wobei die Home-Taste sich an der rechten Seite befindet.

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

- Legen Sie die Scankarte auf eine ebene Fläche und halten Sie das iPad parallel über die Karte.

  Wenn sich die Karte in der Mitte der Kamera befindet, erkennt die S3 Scanner-App automatisch den Strichcode, erfasst die Daten und kehrt zum Tab-Fenster „Scan“ zurück. Sie können dann einen Scan durchführen.

- Sollte die Kamera den Strichcode aus irgendeinem Grund nicht korrekt erfassen können, tippen Sie zum manuellen Eingeben der Scankarte oben links auf die entsprechende Schaltfläche.

  Dann öffnet sich ein Eingabefenster und die digitale Tastatur des iPad mini wird angezeigt.

- Geben Sie die Scankartennummer mithilfe der Tastatur in das Eingabefeld ein. Tippen Sie nach dem Eingeben der Scankartennummer auf die Eingabetaste (Enter-Taste) der digitalen Tastatur.

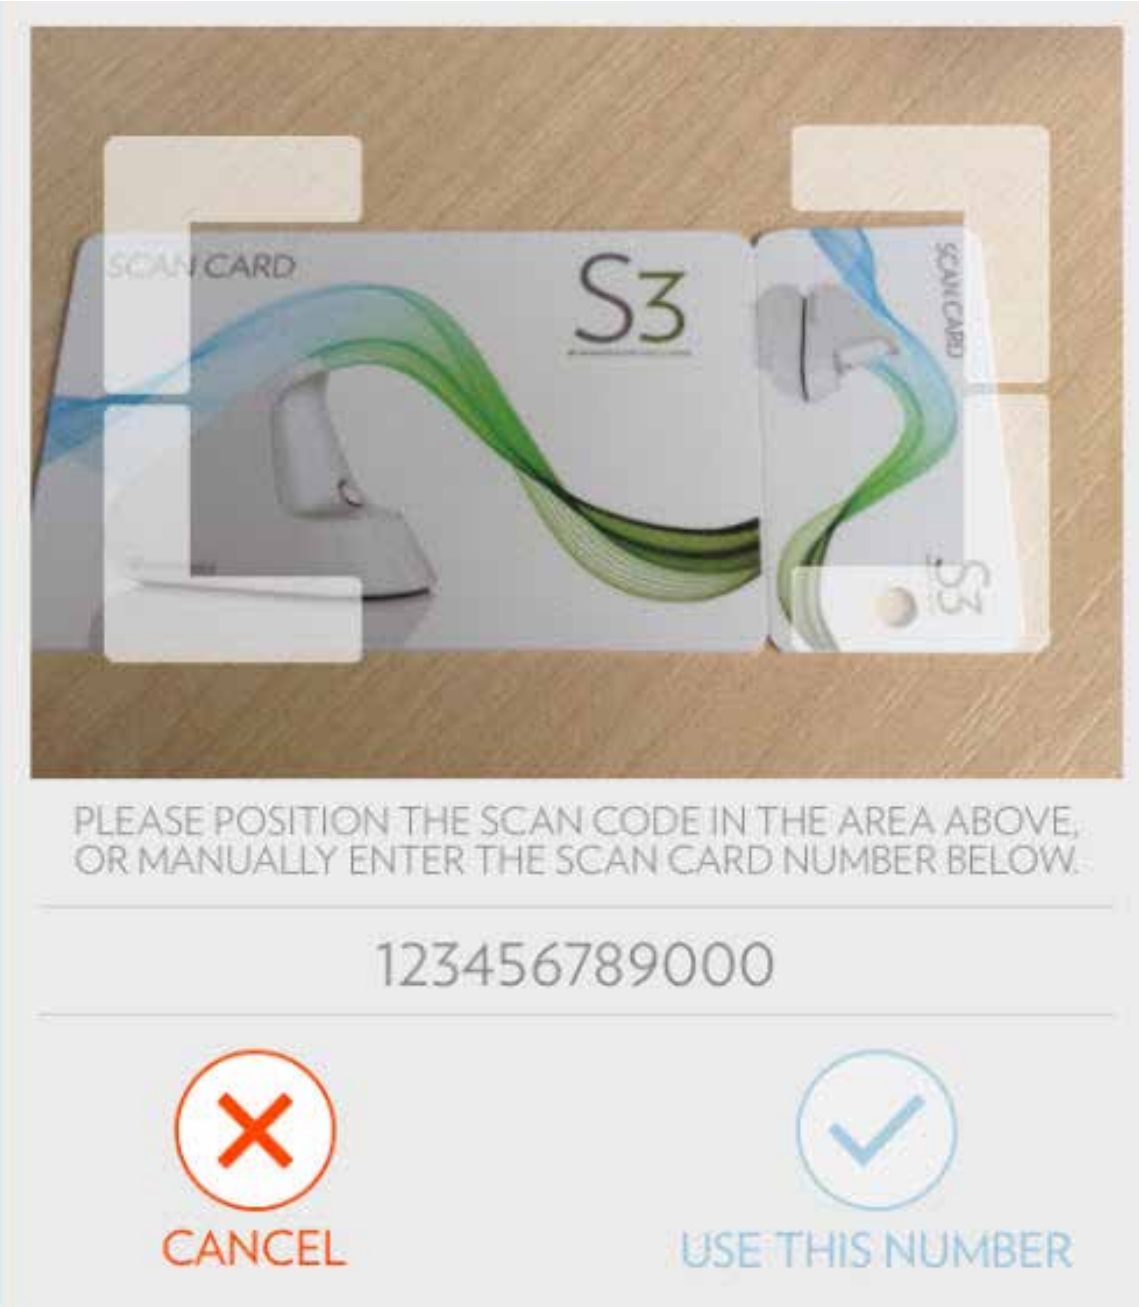

PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE, OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

123456789000

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

Die App kehrt dann zum Tab-Fenster „Scan“ zurück und ist bereit, einen Scan durchzuführen. Wurde die Scankartennummer nicht richtig eingegeben, zeigt die S3 Scanner-App die Mitteilung an, dass die Nummer ungültig ist, und bittet Sie, es erneut zu versuchen.

Um zum Tab-Fenster „Scan“ zurückzukehren, ohne eine Scankartennummer einzulesen oder einzugeben, tippen Sie auf „Abbrechen“.

Nun sind Sie bereit, Personen zu scannen. Geben Sie zunächst den Namen der Person in das Feld „Zu scannende Person“ ein.

Dann wird folgende Nachricht für die zu scannende Person angezeigt:

> „BITTE HALTEN SIE EINE HAND VOR DEN SCANNER“.

Sobald die Hand auf die Linse des S3 gelegt wird, beginnt die Scansitzung automatisch und erfolgt in 3 verschiedenen Schritten:

- Erfassung
- Initialisierung
- Scannen

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

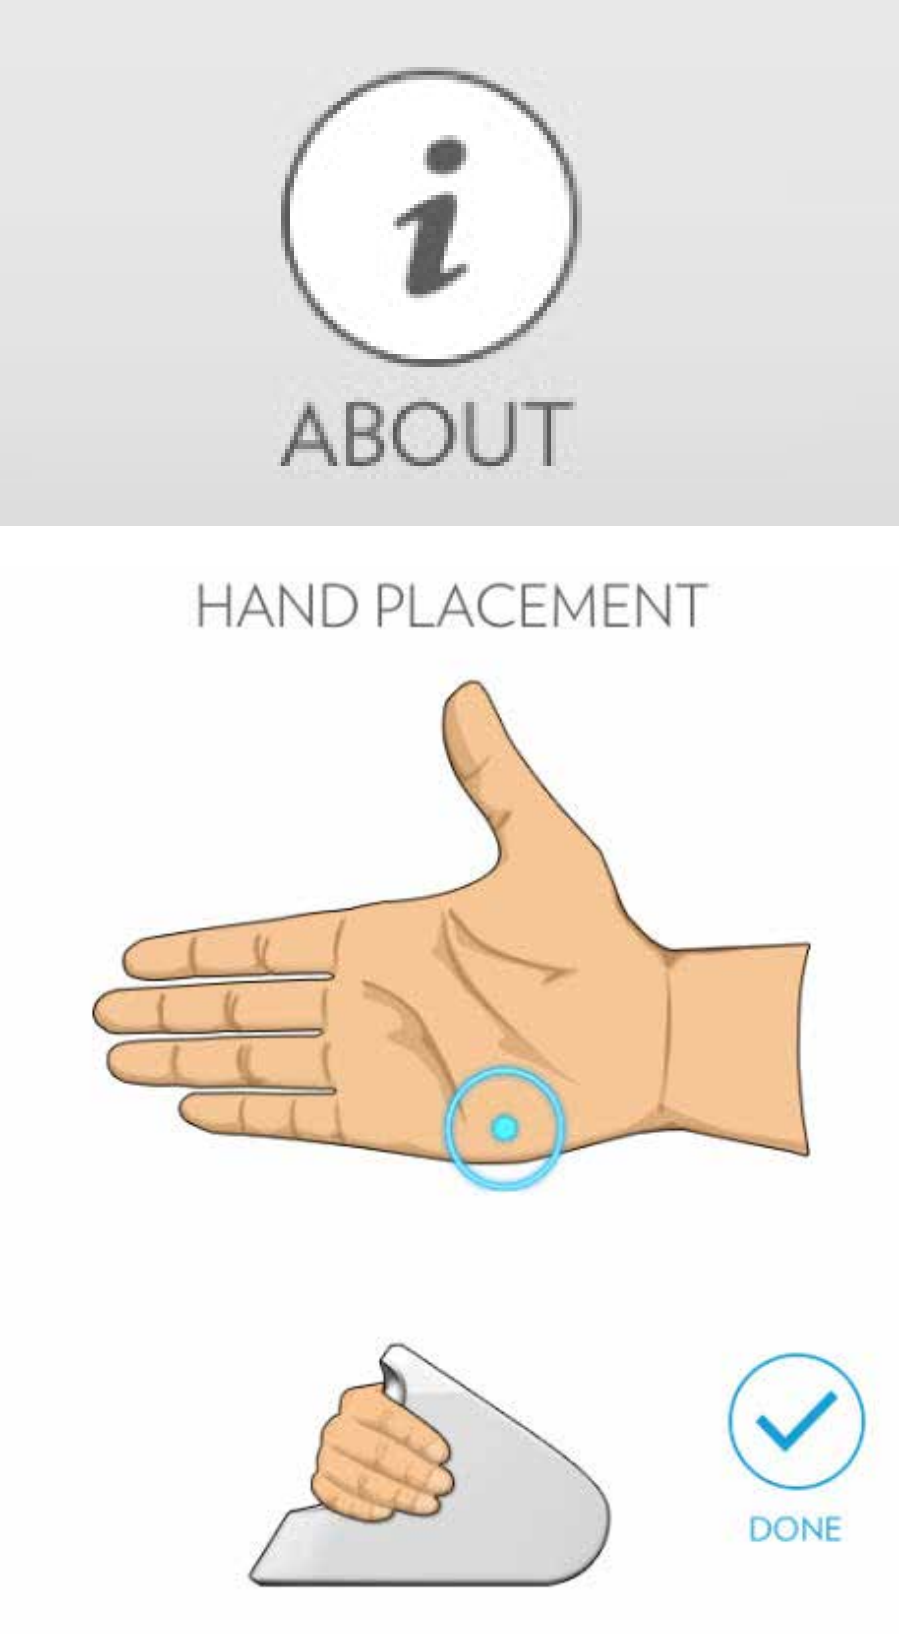

Zeigen Sie, wie die Hand zum korrekten Scannen positioniert werden sollte.

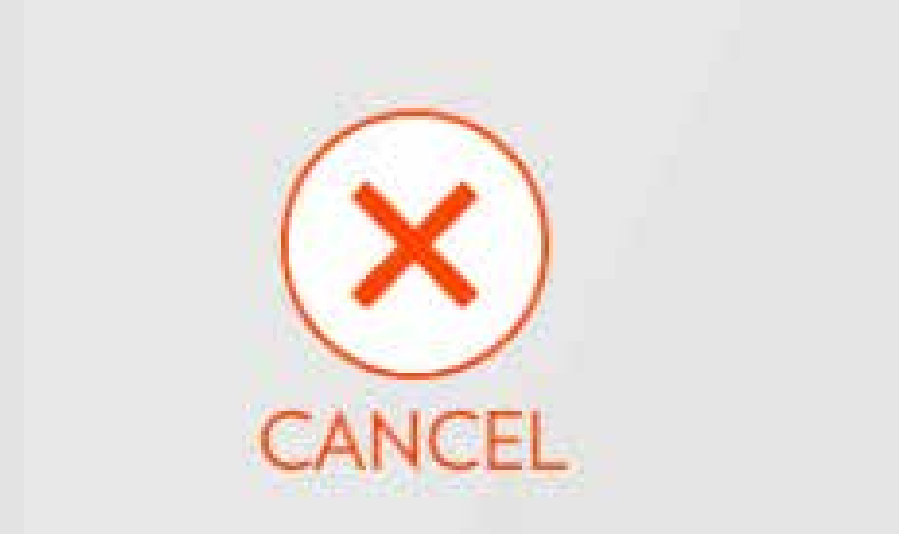

Zum Abbrechen der Scansitzung und zum Zurückkehren in das Tab-Fenster „Scan“

Der Scan dauert etwa 30 Sekunden. Die Hand sollte so lange auf dem Messgerät bleiben, bis sowohl in der S3 Scanner-App als auch auf dem Display des Scanners der Wert angezeigt wird.

WEITER >

DER TAB „STATUS“
DER TAB „SCAN“
ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

Der Scan ist nun beendet. Im Scanfenster werden jetzt 2 Optionen angezeigt:

- Sie können die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und ihm das Scan-Ergebnis per E-Mail zusenden. Die E-Mail wird erstellt und von Nu Skin Enterprises versendet, doch der Kunde erhält die Möglichkeit, Ihnen direkt darauf zu antworten.
- Sie können in der Leiste unten Angaben zur Person festhalten, um einen besseren Einblick in deren Gesamtprofil zu erhalten.

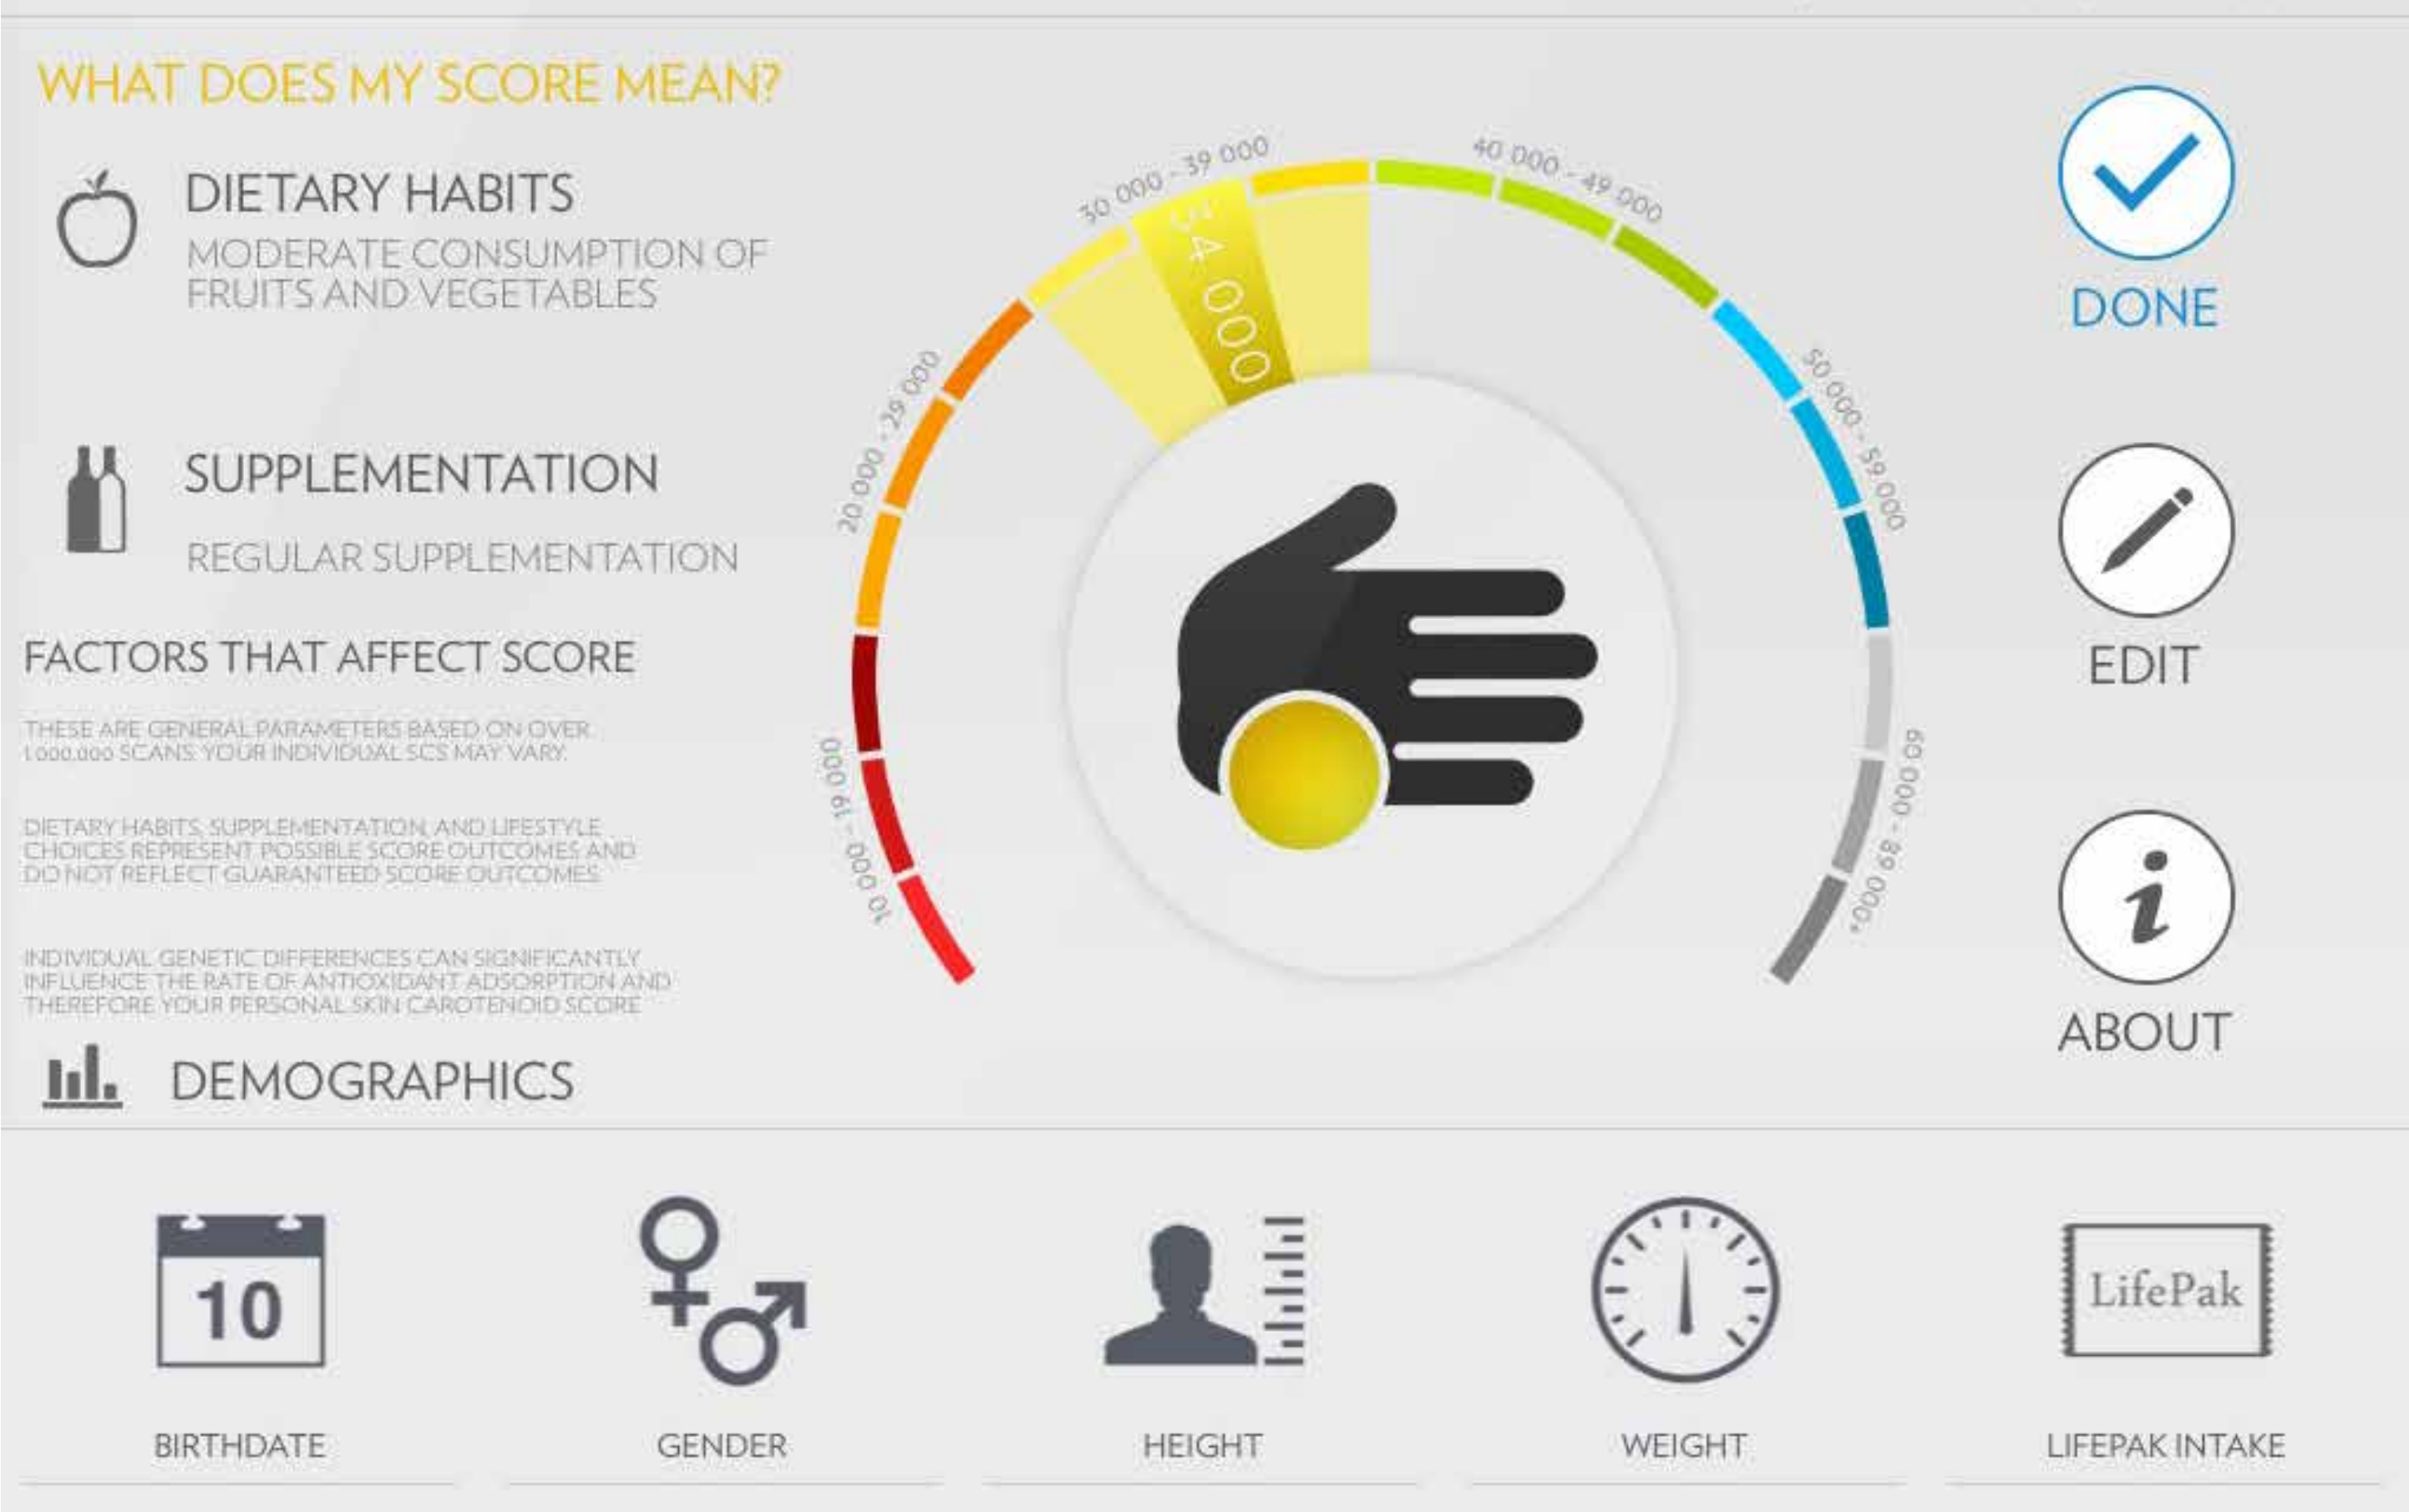

WHAT DOES MY SCORE MEAN?

DIETARY HABITS
MODERATE CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES

SUPPLEMENTATION
REGULAR SUPPLEMENTATION

FACTORS THAT AFFECT SCORE

THESE ARE GENERAL PARAMETERS BASED ON OVER 1,000,000 SCANS. YOUR INDIVIDUAL SCS MAY VARY.

DIETARY HABITS, SUPPLEMENTATION, AND LIFESTYLE CHOICES REPRESENT POSSIBLE SCORE OUTCOMES AND DO NOT REFLECT GUARANTEED SCORE OUTCOMES.

INDIVIDUAL GENETIC DIFFERENCES CAN SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE RATE OF ANTIOXIDANT ADSORPTION AND THEREFORE YOUR PERSONAL SKIN CAROTENOID SCORE.

DEMOGRAPHICS

10 000 - 19 000
20 000 - 29 000
30 000 - 39 000
34 000
40 000 - 49 000
50 000 - 59 000
60 000 - 89 000+
DONE
EDIT
ABOUT
10
BIRTHDATE
GENDER
HEIGHT
WEIGHT
LifePak
LIFEPAK INTAKE

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

DER TAB „SCAN“

Um die Scansitzung zu beenden, tippen Sie auf „Fertig“, und Sie kehren zur Startseite des Tabs „Scan“ zurück, wo Sie sich entweder für digitale Scancredits oder eine Scankarte entscheiden können.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Fertig“ getippt haben, können Sie den Wert des Kunden nicht mehr anzeigen.

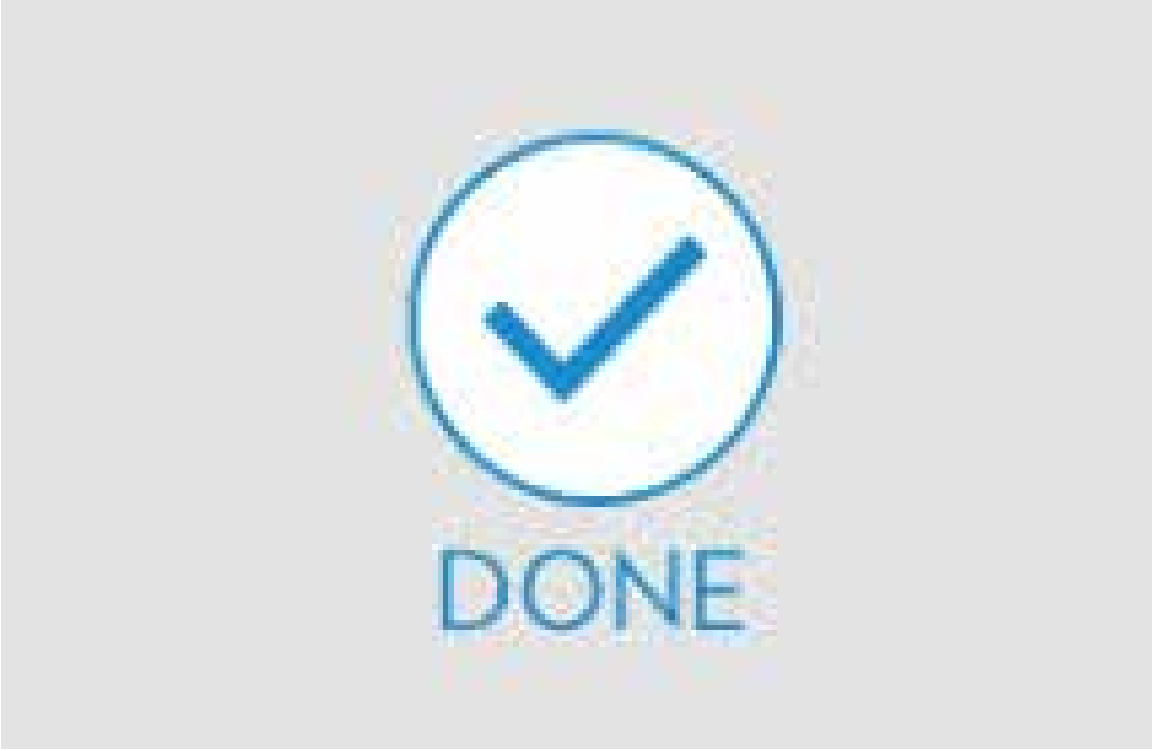

WEITER >

DER TAB „STATUS“

DER TAB „SCAN“

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

ERGEBNIS-FENSTER – PERSÖNLICHE ANGABEN

Beim Tippen auf das jeweilige Symbol wird ein Touch-Menü angezeigt, über das Sie die Option auswählen können, die das Profil der Person am besten beschreibt. Diese Informationen helfen Nu Skin®, das Profil der Person aufzuzeichnen und statistische Daten aufzubereiten.

Die Eingabe solcher persönlichen Informationen ist zum Ermitteln von Scan-Ergebnissen nicht notwendig, sondern optional. Allerdings möchten wir Ihnen dringend empfehlen, bei jeder Scansitzung so viele Informationen wie möglich über die jeweilige Person zu erfassen. Seien Sie beim Eingeben dieser Informationen möglichst genau und sorgfältig. Nur so können aussagekräftige Statistiken erstellt werden.

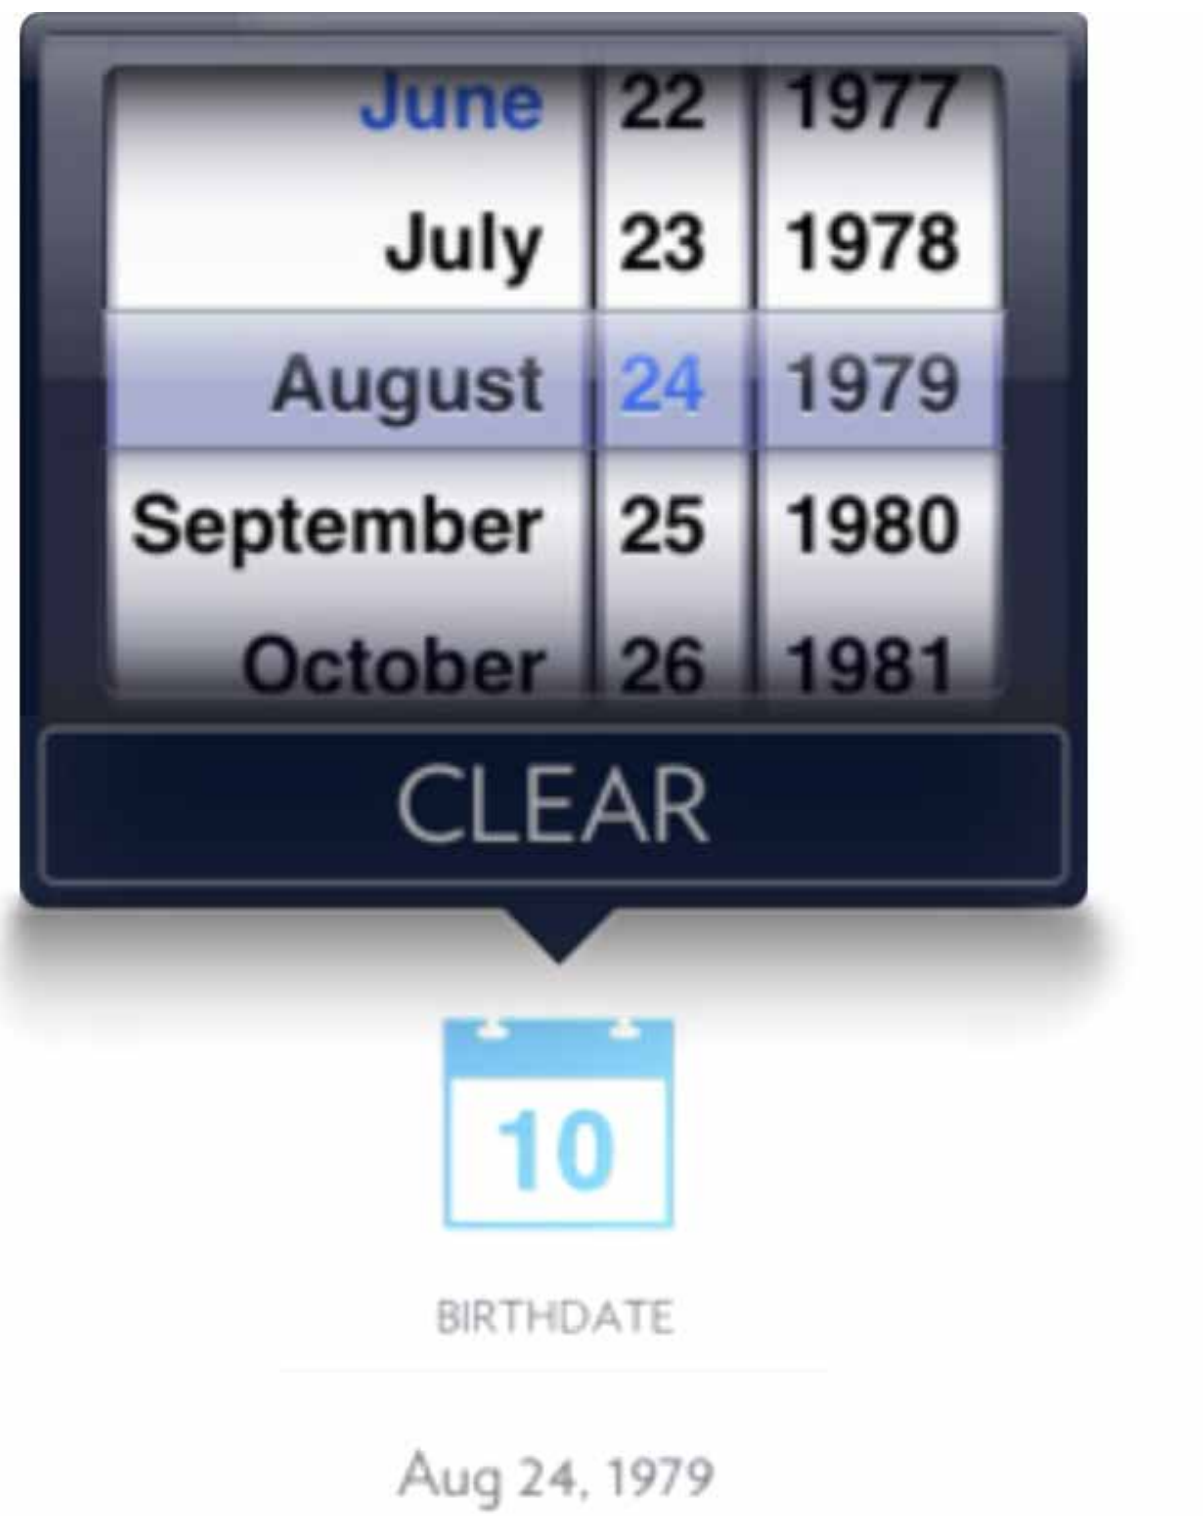
June 22 1977
July 23 1978
August 24 1979
September 25 1980
October 26 1981
CLEAR
10
BIRTHDATE
Aug 24, 1979

WEITER >

DEN S3 SYNCHRONISIEREN

RECORDS

Im Tab „Berichte“ der S3 Scanner-App wird eine digitale Kopie aller abgeschlossenen Scans hinterlegt. Tippen Sie auf den Tab „Berichte“, um das Fenster mit den Berichten zu öffnen. Es wird eine Liste Ihrer durchgeführten Scans in chronologischer Reihenfolge nach Datum und Zeit angezeigt (der letzte Scan zuerst).

Sie werden bemerken, dass die durchgeführten Scans mit der Anmerkung „Ausstehend“ oder „In Bearbeitung“ versehen sind. Daran sehen Sie, ob ein Bericht mit dem Nu Skin® Server synchronisiert wurde. Ein synchronisierter Bericht wird mit dem Vermerk „In Bearbeitung“ angezeigt, wohingegen der Status „Ausstehend“ bedeutet, dass der jeweilige Bericht noch nicht synchronisiert wurde.

Zur Synchronisierung der Berichte zu den durchgeführten Scans, also zur Datenübertragung auf den Nu Skin® Server, müssen Sie mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sein.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

WEITER >

DEN S3 SYNCHRONISIEREN

WICHTIG:

Sie müssen die S3 Scanner-App mindestens einmal monatlich, spätestens am letzten Tag des Monats, mit dem Nu Skin® Server synchronisieren. Andernfalls können Ihre Scans im Hinblick auf die Erfüllung der monatlichen Anforderungen zum Scannerleasing, das Kostenübernahme-Programm, Ihr Persönliches Verkaufsvolumen (PSV) und Ihre Provisionen nicht berücksichtigt werden. Wir empfehlen Ihnen, nach jeder Ihrer Scansitzungen eine Synchronisierung durchzuführen.

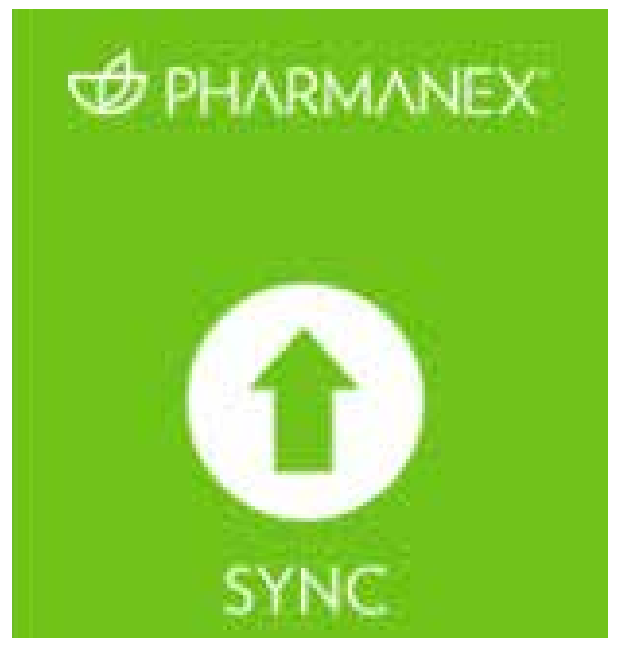

Zum Synchronisieren Ihrer Scanberichte drücken Sie auf „Synchronisation“.

Der Operator-Tab

In diesem Fenster können Sie die Sitzung wechseln und den Markt sowie die gewünschte Sprache auswählen.

WEITER >

43,000
CS70136
20V ⎓ 2A

DEN S3 AUSSCHALTEN

- Trennen Sie zuerst die Verbindung zur S3 Scanner-App. Klicken Sie dazu im Tab „Status“ auf die Schaltfläche „Getrennt“.
- Schließen Sie die S3 Scanner-App, indem Sie auf die Home-Taste des iPads drücken.
- Schalten Sie den Bildschirm des iPads ab, indem Sie kurz auf die Standbytaste drücken.
- Drücken Sie auf der Rückseite des S3 die Ein/Aus-Taste und schalten Sie den Scanner aus. Drücken Sie beim Ausschalten nicht auf die Bluetooth-Taste. Dies ist nicht mehr erforderlich.
- Setzen Sie die Dunkelkappe auf die Linse, um Schäden an der Elektronik vorzubeugen.
- Um den S3 von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Stromadapter aus dem hinteren Ladestecker. Wenn der S3 mit der Stromversorgung verbunden ist, sollten Sie den Stromadapter und den hinteren Ladestecker immer in Reichweite haben.
- Packen Sie den S3 in seine Tragetasche, solange Sie ihn nicht verwenden.

WICHTIG:
Schalten Sie den S3 während eines Scans, oder während er sich im Gebrauch befindet, nicht aus. Wenn der S3 gerade im Akkubetrieb läuft und auf dem Display eine Warnung zum niedrigen Akkustand angezeigt wird, schließen Sie den S3 entweder mit dem mitgelieferten Zubehör an die Stromversorgung an oder schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus.

WEITER >

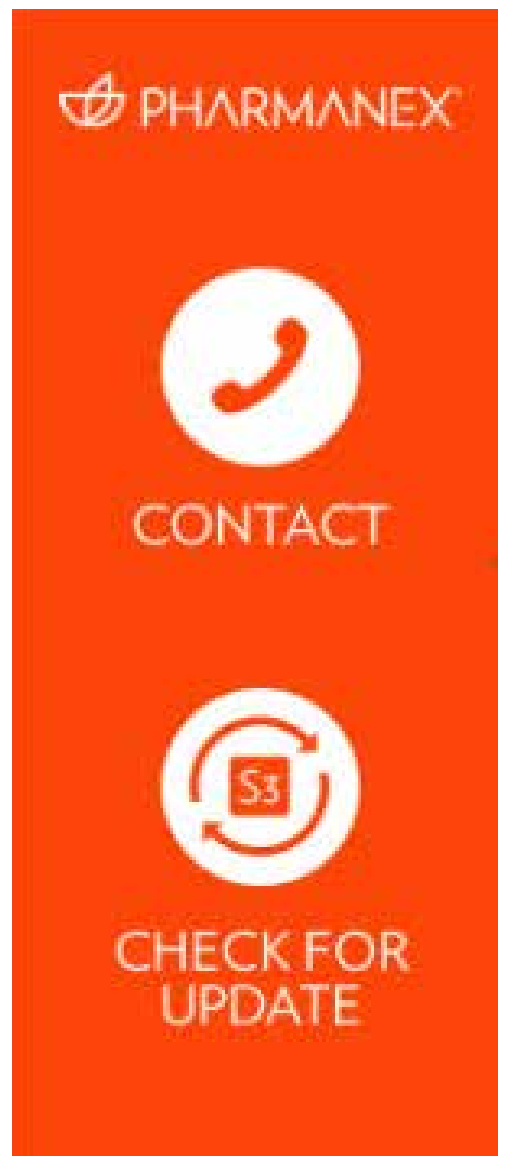
PHARMANEX
CONTACT
S3
CHECK FOR UPDATE

SUPPORT

- Wenn Sie Hilfe benötigen, finden Sie unter „Kontakt“ die E-Mail-Adresse Ihres zuständigen Scanner-Supports und entsprechende Links zu Webseiten.
- Unter „Info“ finden Sie die Software-Version der S3 Scanner-App, die Firmware-Version des S3 und weitere Informationen zu Hard- und Software.

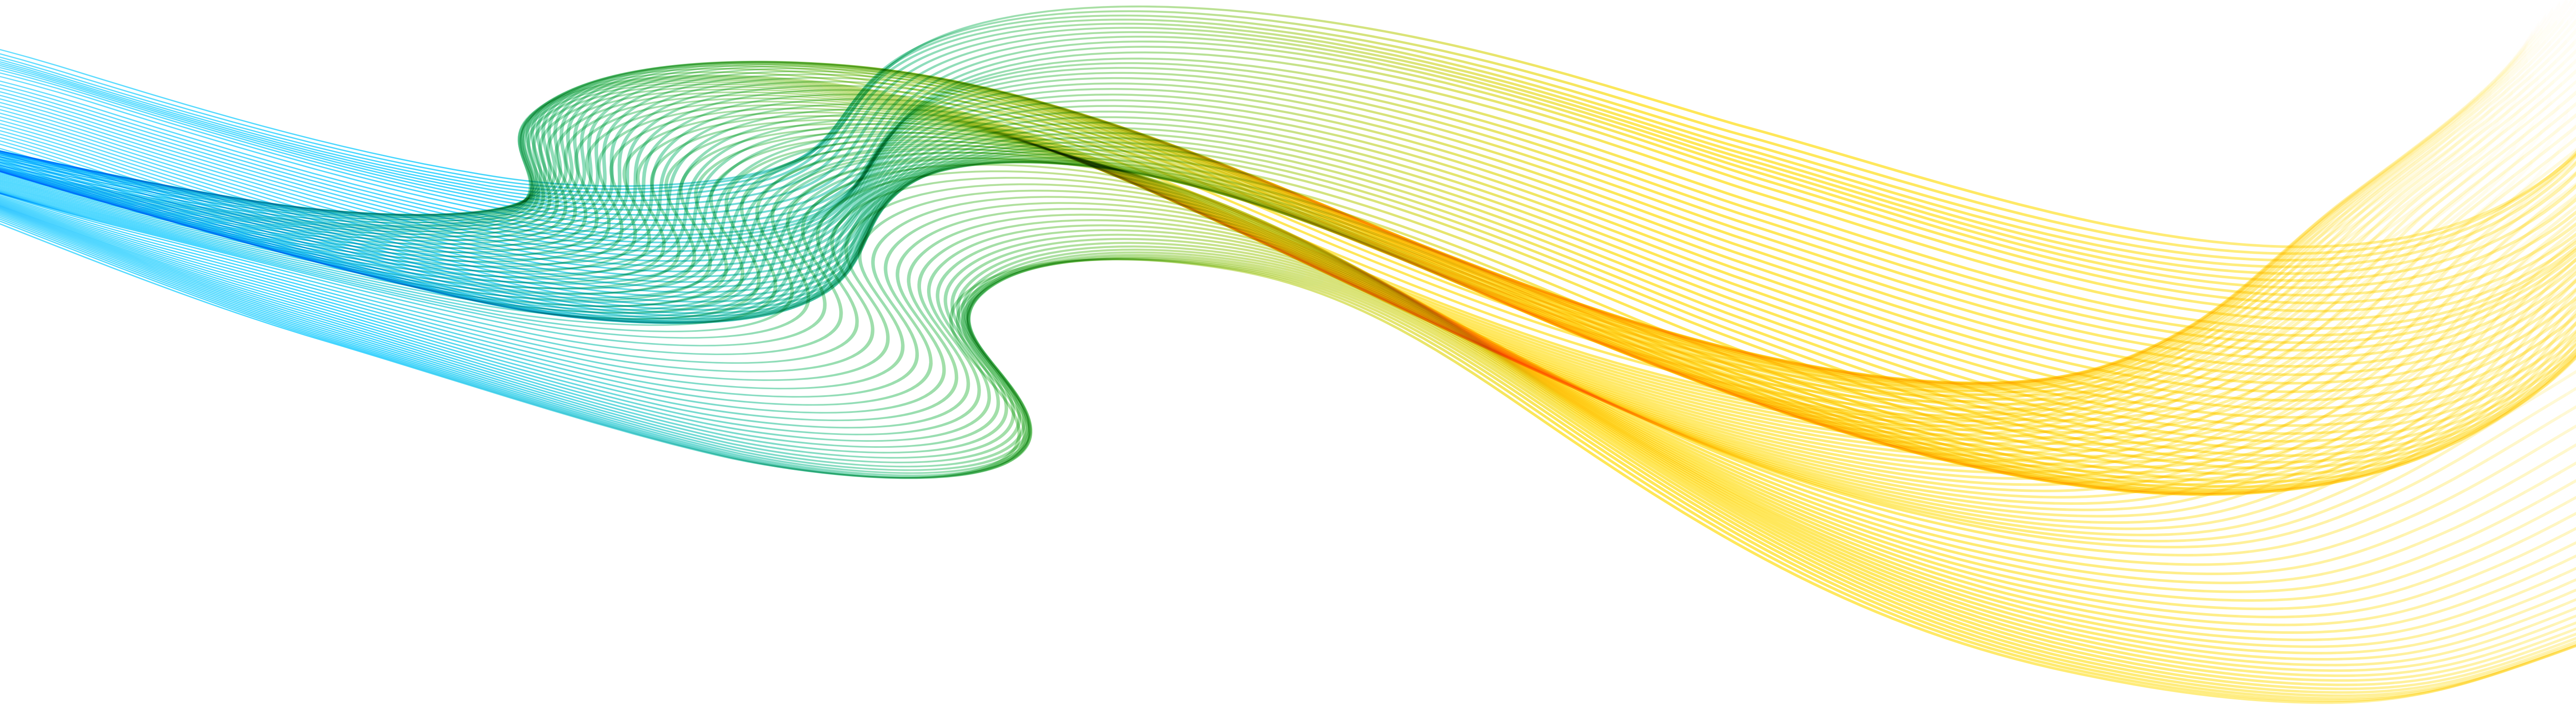

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

Die S3 Scanner-App öffnet sich nicht, wenn ich auf das Symbol im Home-Bildschirm tippe.

- Halten Sie das Symbol zur S3 Scanner-App auf dem Home-Bildschirm gedrückt. Deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch erneut. **Dieser Schritt sollte nur als letzter Ausweg in Betracht gezogen werden, denn dadurch werden alle noch nicht verwendeten Scancredits, die Sie gekauft haben, sowie alle noch nicht synchronisierten Scanergebnisse gelöscht.**

Der S3 Scanner lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Scanner mindestens 8 Stunden aufgeladen haben, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Schließen Sie den S3 mit dem mitgelieferten Stromkabel an eine Steckdose an. Die Ladekontroll-Leuchte auf der Rückseite sollte jetzt (grün) aufleuchten, um den Ladevorgang anzuzeigen. Auch auf dem Display oben am S3 sollte ein Ladesymbol zu sehen sein. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los und betätigen Sie sie dann erneut.

WEITER >

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

TIPPS UND TRICKS

Ich kann mit der S3 Scanner-App keinen Scan durchführen.

- Dies kann verschiedene Gründe haben:
  - Der Scanner ist eventuell nicht über Bluetooth mit dem iPad mini verbunden.
  - Vergewissern Sie sich, dass sich das iPad mini und der Scanner in der richtigen Reichweite zueinander befinden (maximal 30 m).
  - Sie müssen eventuell einen Dunkelkappenscan oder einen Operator-Scan durchführen. Überprüfen Sie dies im Tab „Status".
  - Achten Sie darauf, den Scanner mindestens einmal pro Monat zu synchronisieren.
  - Vergewissern Sie sich, dass Sie entweder einen digitalen Scancredit gekauft oder eine Scankarte erfasst haben.
  - Denken Sie daran, den Namen der Personen im Tab „Scan" einzugeben.

Beim Verwenden einer Scankarte wird die Zahl von der Kamera nicht richtig eingelesen.

- Geben Sie die Kartennummer über die digitale Tastatur manuell in das Textfeld ein.

WEITER ›

TIPPS UND TRICKS

Die S3 Scanner-App gibt an, dass die Scankarte ungültig sei.

- Die Scankarte wurde wahrscheinlich bereits verwendet. Verwenden Sie eine andere Scankarte oder kaufen Sie im Tab „Scan" einen digitalen Scancredit.

Wo finde ich in der S3 Scanner-App meine abgeschlossenen Scans?

- Ihre abgeschlossenen Scans finden Sie in der App im Tab „Berichte".

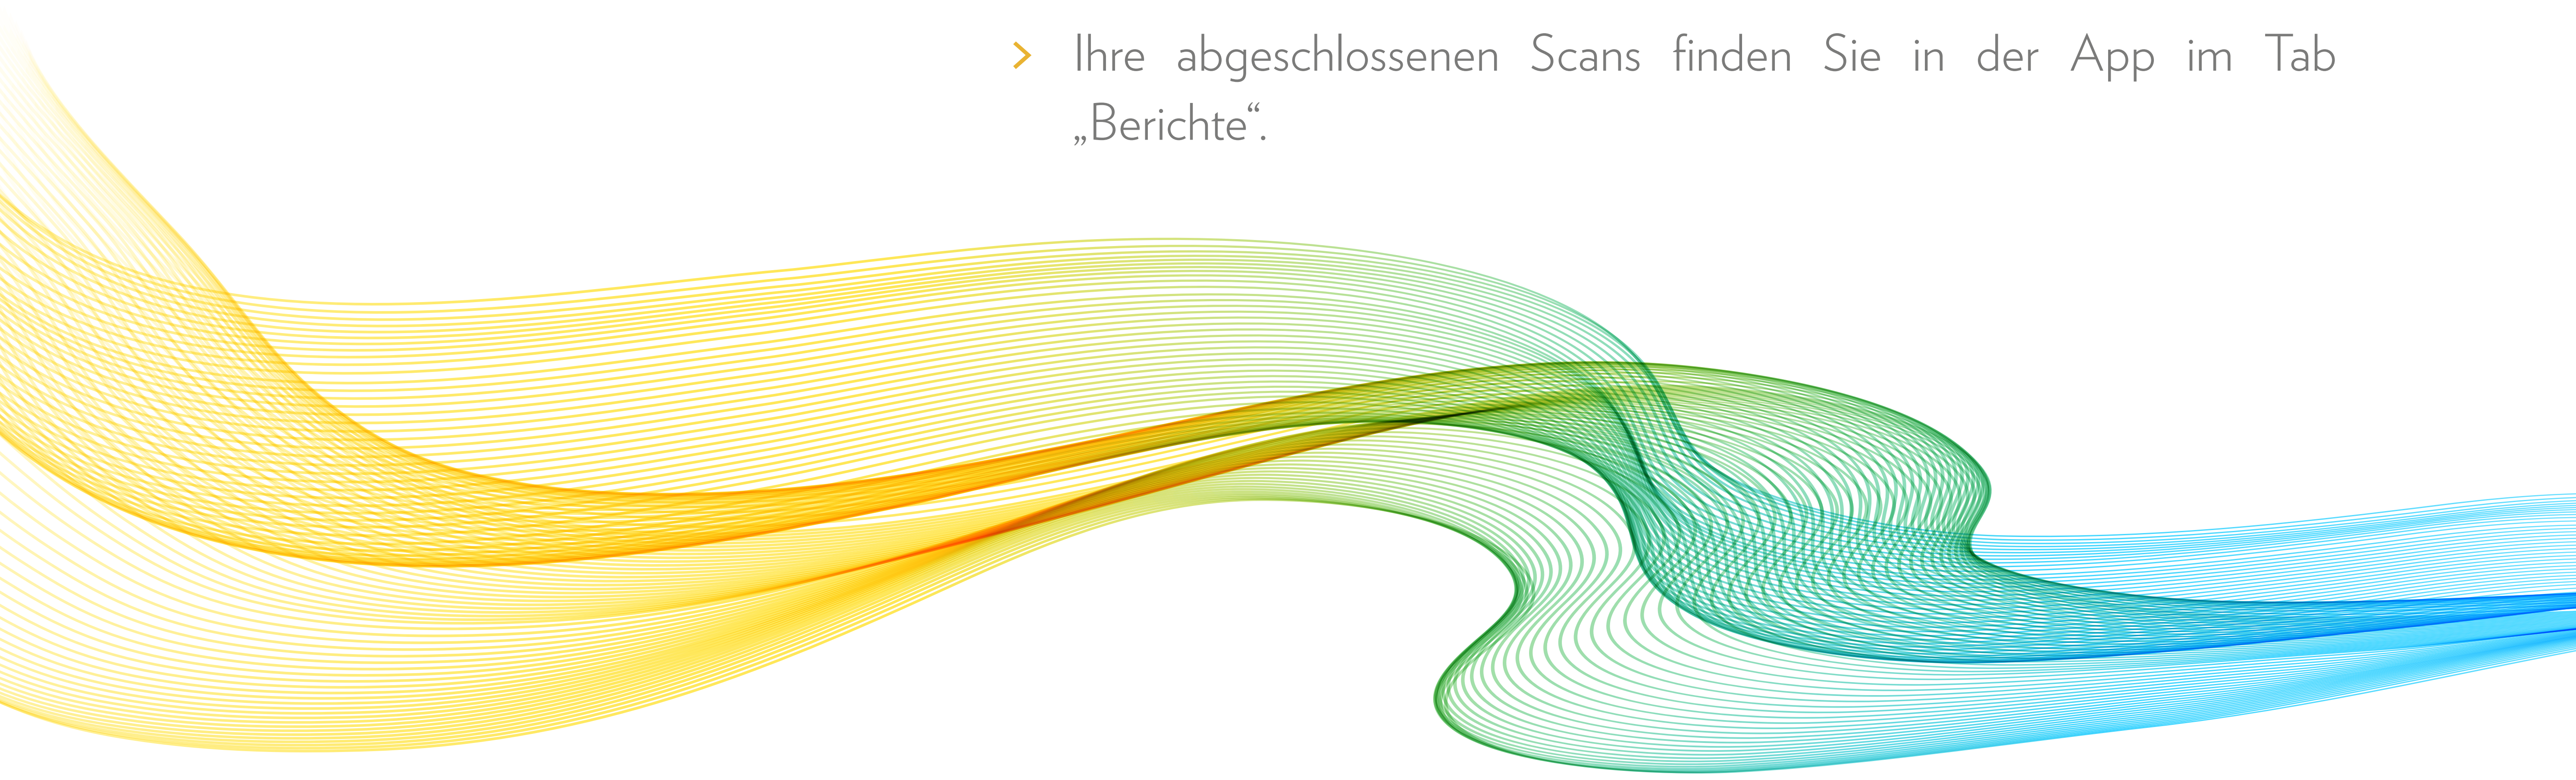

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

SYNCHRONISIERUNG

PHARMANEX
SYNC

Achten Sie darauf, dass das iPad mini mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

Erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Server nicht antwortet, warten Sie bitte 10 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Scanner-Support.

Wenn die Zeit zum Synchronisieren abgelaufen ist, tippen Sie auf die Schaltfläche „Synchronisation“. So erhalten Sie ein neues Zeitfenster.

DUNKELKAPPE

Die Dunkelkappe dient auch als Schutzkappe für die Linse des S3. Die Kappe sollte immer nach dem Scannen, auch zwischen einzelnen Scans, angebracht werden.

REINIGUNG

Durch den wiederholten Hautkontakt beim Scannen bildet sich ein Fettfilm, der die Messungen des Scanners beeinflussen kann. Reinigen Sie regelmäßig die Linse und die Vorderseite des Scanners. Trennen Sie dazu den S3 vom Ladekabel. Geben Sie dann etwas Glasreiniger oder eine milde Seife und Wasser auf ein Mikrofasertuch und fahren Sie damit von oben nach unten über das Gerät. Tauchen Sie den S3 zum Reinigen niemals unter Wasser oder spülen Sie ihn mit Wasser ab. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Lösungsmittel oder Scheuermittel. Zusätzlich empfehlen wir, dass Ihre Kunden vor dem Scannen Nu Skin® Epoch® Hand Purifier benutzen. So kann der Fettfilm auf dem S3 reduziert und eine mögliche Übertragung von Keimen von Person zu Person verringert werden.

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

SCHWANKUNGEN

Schwankungen sind nicht ungewöhnlich, da der Scanner Carotinoide erfasst, die nur in Spurenmengen vorhanden sind und deren Messung in biologischem Gewebe erfolgt.

Zwei Arten von Faktoren beeinflussen den Hautcarotinoidwert

1. Persönliche Faktoren (Erbanlagen, Ernährungsweise)
2. Faktoren bei der Durchführung (Kalibrierung, Temperatur, Handposition, Zugluft)
   85 % aller Messungen weichen um +/- einen Farbton vom Mittelwert ab.

Damit Ihr Scanner präzise Messergebnisse liefert:

- Achten Sie darauf, dass die Hand der Person die gleiche Position an der gleichen Stelle wie beim letzten Scan dieser Person einnimmt.
- Stellen Sie sicher, dass der Scanner mit dem Dunkelkappenscan und dem Operator-Scan richtig kalibriert wurde.
- Scannen Sie Ihre Kunden in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20 °C bis 25 °C.

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

BLUETOOTH

Tipps zur Aufrechterhaltung der Bluetooth-Verbindung:

1. Schalten Sie den Scanner nicht aus, solange die S3 Scanner-App noch ausgeführt wird.
2. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie nicht die Bluetooth-Taste an der Rückseite des Scanners. Dadurch wird die Bluetooth-Verbindung zurückgesetzt; gegebenenfalls führt dies auch zu Signalunterbrechungen.

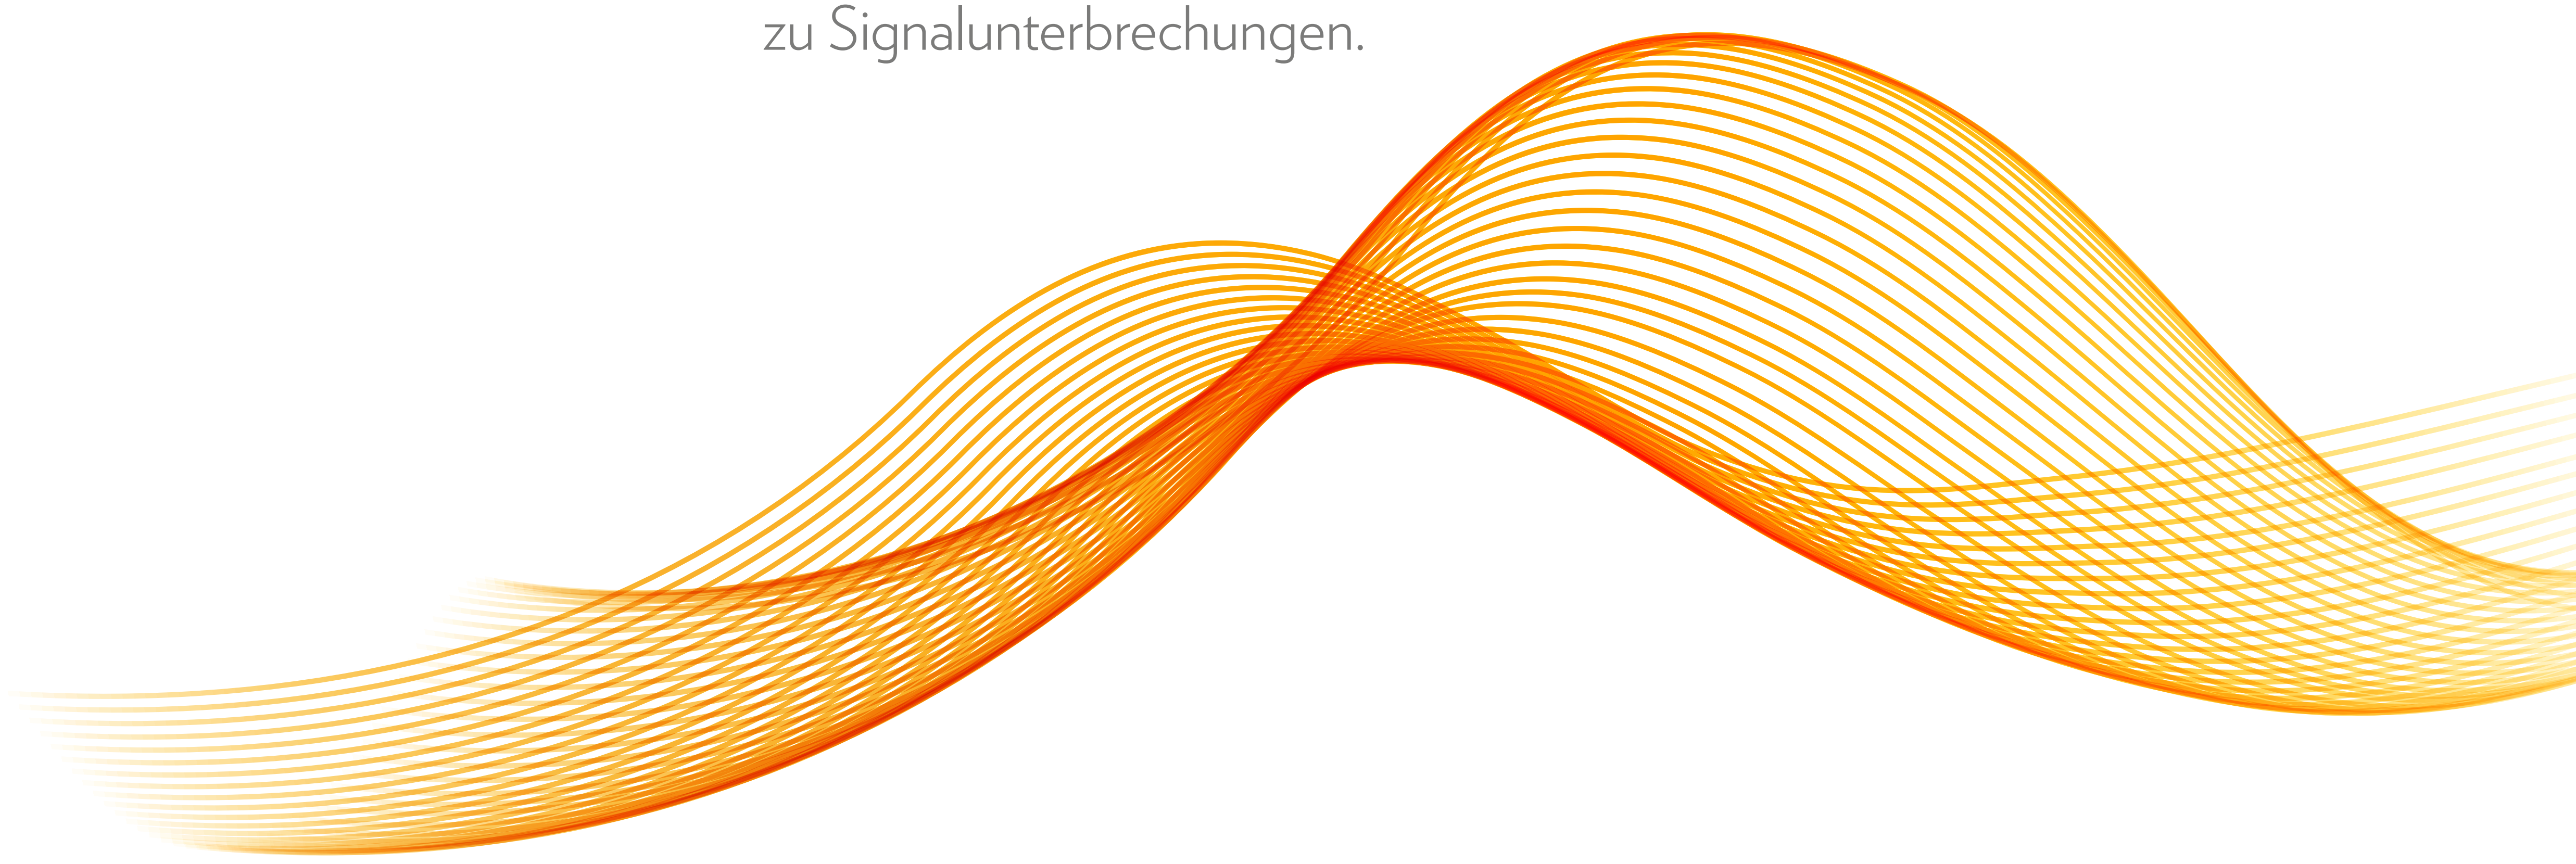

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

BLUETOOTH

Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, versuchen Sie zunächst, das Problem mit einem NEUSTART zu lösen:

1. Halten Sie die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des Scanners 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie blinkt.
2. Beenden Sie die App wie gewohnt.
3. Rufen Sie die S3 Scanner-App erneut auf und sehen Sie im Tab „Status“ nach, ob das Gerät erfolgreich mit dem iPad verbunden wurde.
4. Wurde keine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt, beenden Sie die App und tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“.
5. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus. Warten Sie 2–3 Sekunden. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion dann wieder ein.
6. Rufen Sie die S3 Scanner-App erneut auf und prüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
7. Sollte dieser Vorgang nicht zum Erfolg führen, folgen Sie den Schritten zur Problemlösung durch Ausschalten auf der nächsten Seite.

WEITER >

TIPPS UND TRICKS

PROBLEMLÖSUNG DURCH AUSSCHALTEN

- Beenden Sie die S3 App.
- Schalten Sie den S3 Scanner aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Schalten Sie das iPad aus, indem Sie die Standbytaste 5 Sekunden lang gedrückt halten und den roten Pfeil nach rechts schieben.
- Schalten Sie das iPad dann wieder ein.
- Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“.
- Tippen Sie auf „Bluetooth“ und schalten Sie die Funktion aus.
- Warten Sie 3 Sekunden und schalten Sie die Bluetooth-Funktion wieder ein.
- Schalten Sie den S3 Scanner wieder ein.
- Halten Sie die Bluetooth-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie blinkt.
- Öffnen Sie die S3 Scanner-App.
- Versuchen Sie, eine Verbindung zum Scanner herzustellen.

WEITER >

TECHNISCHE DATEN

- Spannung bzw. Spannungsbereich: Stromversorgung nur mit Typ DOC EMSA 200/200
  - – Input 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A
  - – Output 20 V, 50-60 Hz, 2,0 A
- Umgebungsbedingungen
  - – Innengebrauch bis zu einer Höhe von 2000 m
  - – Sichere Betriebstemperatur: 10° bis 40 °C
  - – Optimale Betriebstemperatur: 20° bis 25 °C
  - – Sichere Aufbewahrungstemperatur: 10° bis 40 °C
  - – Relative Luftfeuchtigkeit: 18 – 85 %
  - – Netzspannung: +10 % bis -10 %
- EMV: 61326-1:2013; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-3-2:2006
- Sicherheit: 61010-1:2010
- Gewicht: (1,46 kg)
- Höhe: (16,8 cm)
- Breite: (23,5 cm)
- Tiefe: (11,6 cm)

[Name and Address of the EU Representative]

Nu Skin Belgium N.V.

Leonardo Da Vincilaan 9

1935 Zaventem – Belgien

Sie finden Ihren Scannerservice-Kontakt in der S3 App unter Support > Kontakt.

WEITER >

TECHNISCHE DATEN

Durch das CE-Etikett eines Produktes erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien (2006/95/EG, 2004/108/EG und 1999/5/EG) entspricht.

Dieses Kennzeichen steht für die Zertifizierung des Gerätes durch Underwriters Laboratories.

Dieses Kennzeichen steht für die Zertifizierung durch die Canadian Standards Association.

Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Alle Bestandteile sind maßgefertigt und dürfen in keiner Weise verändert werden. Sämtliche Garantien erlöschen, wenn Etiketten entfernt, beschädigt oder verändert werden.

Dieses Kennzeichen besagt, dass das Gerät nicht vom Gerätehalter entsorgt werden darf, sondern zur Entsorgung an Pharmanex® LCC zurückgeschickt werden muss.

Der S3 entspricht als digitales Gerät der Klasse B den Anforderungen gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, (2) und das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen können.

Hält die Beschränkungen der Richtlinie zur Verwendung gefährlicher Stoffe ein (Richtlinie 2011/65/EG).